



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie (dénommé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s) :

TYPE OF DEVICE

Electricity Meters: Energy and Demand

TYPE D'APPAREIL

Compteurs d'électricité: énergie et puissance

APPLICANT / REQUÉRANT

Sensus Metering Systems
33 Isaacson Cres.
Aurora, Ontario, Canada
L4G 3H5

MANUFACTURER / FABRICANT

Sensus Metering Systems
PO Box 528
805 Liberty Blvd.
Dubois, Pennsylvania, USA
15801

MODEL(S) / MODÈLE(S)

BSA4
BNA4

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SECTION 1 – Ratings and Specifications

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé

The **BSA4** and **BNA4** are static integrating socket meters available in “self-contained” and “transformer type” configurations.

Les **BSA4** et **BNA4** sont des compteurs intégrateurs statiques à socle disponibles en version « autonome » et en version « type à transformateur ».

Service Configurations / Configurations des services

- ① 1 element, 2 wire / 1 élément 2 fils
- ② 1 ½ element 3 wire / 1 ½ éléments 3 fils
- ③ 2 element 3 wire 1Φ / 2 éléments 3 fils 1Φ
- ④ 2 element 3 wire network / 2 éléments 3 fils réseau
- ⑤ 2 element 3 wire Δ / 2 éléments 3 fils Δ
- ⑥ 2 element 4 wire Y / 2 éléments 4 fils Y
- ⑦ 2 element 4 wire Δ / 2 éléments 4 fils Δ
- ⑧ 2 ½ element 4 wire Y / 2 ½ éléments 4 fils Y
- ⑨ 2 ½ element 4 wire Δ / 2 ½ éléments 4 fils Δ

- ⑩ 3 element 4 wire Y / 3 éléments 4 fils Y
- ⑪ 3 element 4 wire Δ / 3 éléments 4 fils Δ
- ⑫ Auto Service Detect / Détection du type du branchement
- ⑬ Socket Type (S-Base) / Type de socle (socle S)
- ⑭ Bottom Connected (A-Base) / Socle à connexion par le bas (socle A)
- ⑮ Switchboard Style / Type pour tableau de distribution
- ⑯ Multi Customer Metering System / Systèmes de mesurage à clients multiples

The meter is approved with the following service configurations :

Le compteur est approuvé avec les configurations de service suivantes :

Model / Modèle	Service Configurations / Configurations de service	Voltage / Tension (V)	Current / Courant (A)
BSA4	①⑬	120 V	1 A – 200 A
			0.1 A – 20 A
	②⑬	240 V	0.1 A – 20 A
		240 V	1 A – 200 A
BNA4	③④⑬	120 V	1 A – 200 A

Specifications / Caractéristiques

Frequency / Fréquence (Hz)	Temperature Range / Gamme de température		Meter Burden / Fardeau du compteur
60 Hz	Min (°C) :	Max (°C) :	3.0 VA capacitive / capacitif (120 V) 6.7 VA capacitive / capacitif (240 V)
	-40 °C	+53 °C	
Maximum Voltage Transformer Wire Length / Longueur maximale du fil du	---		

transformateur de tension		
Maximum Current Transformer Wire Length / Longueur maximale du fil du transformateur de courant	---	
Approved Current Transformers / Transformateurs de courant approuvés	---	
Auxiliary Power Supply / Alimentation électrique auxiliaire	<input type="checkbox"/> Yes / Oui <input checked="" type="checkbox"/> No / Non	---
Approved Legally Relevant Software / Logiciel juridiquement pertinent approuvé	6.05	

SECTION 2 – Summary Description

PARTIE 2 – Description sommaire

Model / Modèle	BSA4 / BNA4
Approved Energy and Loss Quantities / Énergie et grandeurs des pertes approuvées	
Delivered Energy / Énergie livrée	kWh kvarh kVAh
Received Energy / Énergie reçue	kWh kvarh kVAh
Net Energy / Énergie nette	kWh kvarh
Loss Quantities / Grandeur des pertes	---
Approved Demand / Puissance appelée approuvée	
Block Interval / À période d'intégration	kW kvar kVA
Sliding Window / Fenêtre mobile	kW kvar kVA
Thermal / Thermique	---
Demand Interval / Variation en fonction du facteur de puissance	1 x 60 minute 1 x 15 minute 3 x 5 minute
Demand Reset Device Information / Informations sur le mécanisme de remise à zéro de la puissance appelée	The demand values can be reset using Spotlight software via the meter's optical port or its wireless FlexNet communications. Les valeurs de demande peuvent être réinitialisées à l'aide du logiciel Spotlight via le port optique du compteur ou ses communications sans fil FlexNet.
Approved Test Mode and Test Provisions / Mode d'essai et moyens d'essai approuvés	
Energy Test Provision / Moyens d'essai d'énergie	kWh kvarh kVAh
Test Provision Information / Informations sur les moyens d'essai	The meter's test provision is an infrared LED located in the optical port on the front of the meter. The LED can switch between energy units by double-pressing the button to the left of the meter's display at startup or by using the Spotlight software on a computer connected to the meter through its optical port. Le moyen d'essai du compteur est une DEL infrarouge située dans le port optique situé sur le devant du compteur. La DEL peut passer d'une unité d'énergie à l'autre en appuyant deux fois sur la touche située à gauche de l'écran du compteur au démarrage soit en utilisant le logiciel Spotlight sur un ordinateur connecté au compteur par son port optique..
Test Mode - Energy / Mode d'essai - Énergie	---
Test Mode - Demand / Mode d'essai – Puissance appelée	---
Approved Test Mode Demand Interval Length(s) / Durée de la période d'intégration de la puissance appelée en mode d'essai approuvé	---
Test Mode Information / Informations sur le mode d'essai	---

Model / Modèle	BSA4 / BNA4
Approved Internal Pulse Recorder / Enregistreur interne d'impulsions approuvé	
Internal Pulse Recorder / Enregistreur interne d'impulsions	kWh kvarh kVAh
Number of channels / Nombre de voies	8
Approved External Pulse Recorder / Enregistreur externe d'impulsions approuvé	
External Pulse Recorder / Enregistreur externe d'impulsions	---
Number of Channels / Nombre de voies	---
Type of Input / Type d'entrée	---
Rated Maximum Voltage/ Tension nominale maximale	---
Rated Maximum Frequency (Hz) / Fréquence nominale maximale (Hz)	---
Approved Pulse Outputs / Sorties d'impulsions approuvées	
KZ Pulse Output / Sorties d'impulsions KZ	---
KYZ Pulse Output / Sorties d'impulsions KYZ	---
Other Pulse Output / Autres sorties d'impulsions	---
Pulse output information / Informations sur les sorties d'impulsions	---
Other Options / Autres options	
Service Disconnect / Interrupteur-sectionneur	Available on all 200 A meters. / Disponible sur tous les compteurs de 200 A.
Time of Use Function (TOU) / Fonction temps d'utilisation (TU)	kWh kvarh kVAh
Number of Time of Use Rates / Nombre de registres de facturation de la fonction TU	7 individual rates and 1 total rate / 7 tarifs individuels et 1 tarif total
TOU Conditions or Limitations / Conditions ou restrictions du TU	The rate switching function of the meter is not subject to Measurement Canada specifications. La fonction de commutation des tarifs du computer n'est pas assujettie aux normes de Mesures Canada
Transformer and Line Loss Compensation / Compensation des pertes de lignes et des transformateurs	---
Displays / Affichages	
Display Modes / Modes d'affichage	Normal

Model / Modèle	BSA4 / BNA4
Display Information / Informations sur l'affichage	The meter only has one display mode. The meter's various registers are identified with unique identifiers that are listed on the meter's nameplate. Le compteur n'a qu'un seul mode d'affichage. Les différents registres du compteur sont identifiés par des identificateurs uniques figurant sur la plaque signalétique du compteur.


SECTION 3 – Communications

PARTIE 3 - Communications

3.1 Communication Interfaces		3.1 Interfaces de communication
① Optical Port / Port optique ② Internal Modem / Modem interne ③ RS-232 / RS-232		④ RS-485 / RS-485 ⑤ Ethernet / Ethernet ⑥ Other / Autres
Model / Modèle		BSA4 / BNA4
Communication Interface / Interface de communication		(1)
Comments / Notes		---

3.2 Index of Communication Modules		3.2 Index des modules de communication
<i>The meter is approved when equipped with any one of the following communication modules:</i>		<i>Le compteur est approuvé lorsqu'il est équipé d'un des modules de communication suivants :</i>
Manufacturer / Fabricant		Device / Appareil
Sensus		FlexNet
		Zigbee

3.3 Communication Module Details		3.3 Détails de module de communication	
Communication Types / Types de communication		Functions / Fonctions	
① Radio Frequency Communication (RF) / Communication de radiofréquence (RF) ② Power Line Carrier (PLC) / Courants porteurs en ligne (CPL) ③ Modem / Modem ④ Other Communication Type / Autres types de communication		⑤ Energy Function / Fonction d'énergie ⑥ Demand Function / Fonction de puissance appelée ⑦ Pulse Recorder / Enregistreur d'impulsions ⑧ Time Of Use / Temps d'utilisation ⑨ Remote Disconnect / Sectionneur à distance ⑩ Other Functionality / Autres fonctionnalités	
Sensus			
Device / Appareil	Communications Type / Type de communication	Additional Functions / Fonctions supplémentaires	Burden / Fardeau
FlexNet	(1)	--	See section 1 / Voir section 1
FlexNet communication is integrated on the main PCB of all meters. The FlexNet ID of a meter is listed on the meter's nameplate. The legally non-relevant FlexNet software is updateable. La communication FlexNet est intégrée sur le circuit imprimé principal de tous les compteurs. L'identification FlexNet d'un compteur est indiquée sur la plaque signalétique du compteur. Le logiciel juridiquement non-pertinent FlexNet peut être mis à jour.			

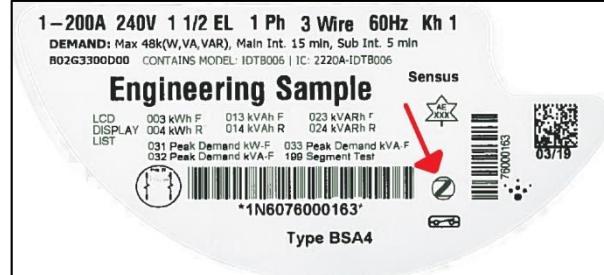
3.3 Communication Module Details		3.3 Détails de module de communication	
Communication Types / Types de communication		Functions / Fonctions	
Device / Appareil	Communications Type / Type de communication	Additional Functions / Fonctions supplémentaire	Burden / Fardeau
ZigBee	①	---	See section 1 / Voir section 1
<p>ZigBee communication is optional and is integrated on the main PCB of the meter. The legally non-relevant ZigBee software is updateable.</p> <p>La communication ZigBee est optionnelle et est intégrée sur le circuit imprimé principal du compteur. Le logiciel juridiquement non-pertinent ZigBee peut être mis à jour.</p>		 <p>1-200A 240V 1 1/2 EL 1 Ph 3 Wire 60Hz Kh 1 DEMAND: Max 48k(W,VA,VAR), Main Int. 15 min, Sub Int. 5 min B02G3300D000 CONTAINS MODEL: IDTB006 IC: 2220A-IDTB006 Engineering Sample LCD 003 kWh F 013 KVARH F 023 KVARH F DISPLAY 004 kWh R 014 KVARH R 024 KVARH R LIST 031 Peak Demand KW-F 033 Peak Demand KVA-F 032 Peak Demand kVA-F 100 Segment Test *1N6076000163* Type BSA4 Sensus</p>	

SECTION 4 – Sealing

PARTIE 4 – Scellage

Index	
<ul style="list-style-type: none"> ① Single Seal / Sceau unique ② Dual Seal / Sceau double ③ Multiple Seal (Specify) / Sceau multiple (spécifiez) 	<ul style="list-style-type: none"> ④ Firmware Security Setting / Paramètres de sécurité du micrologiciel ⑤ Programming jumper / Cavalier de programmation ⑥ Lockout procedure / Procédure de verrouillage ⑦ Plug / Bouchon ⑧ Other / Autres

Model / Modèle	BSA4 / BNA4
Sealing Information / Information de scellage	
Physical Seal / Sceau physique	①
Programming Seal / Sceau de programmation	⑧
Comments / Notes	<p>To reprogram the legally relevant meter software, the meter's seal must be removed and the clear, outer cover must also be removed. There is a push button located at the bottom, left corner of the display that is accessed via a flap/lever in the grey register cover. This push button must be depressed in order to reprogram the legally relevant meter software.</p> <p>Pour reprogrammer le logiciel juridiquement pertinent du compteur, il faut enlever le sceau du compteur ainsi que le couvercle extérieur transparent. Il y a un bouton-poussoir situé dans le coin inférieur gauche de l'écran, auquel on accède par un clapet/levier dans le couvercle gris du registre. Ce bouton-poussoir doit être enfoncé pour reprogrammer le logiciel juridiquement pertinent du compteur.</p>

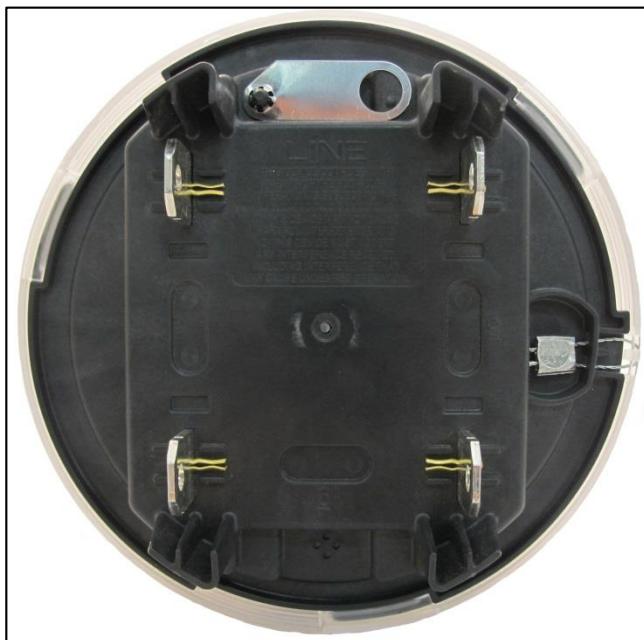

Physical seal / Sceau physique

SECTION 5 – Nameplates and Photos



Angled view / Vue en angle




Front view / Vue de face

PARTIE 5 – Plaques signalétiques et photos



Side view / Vue latérale

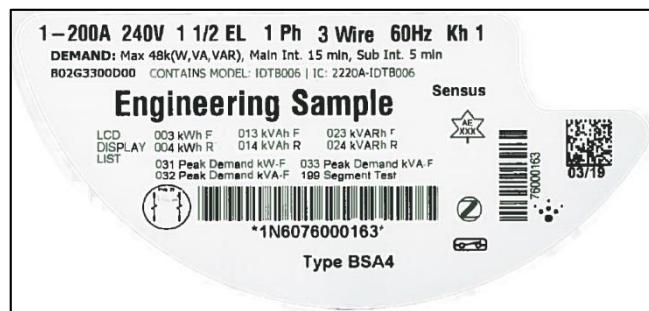

Nameplate / plaque signalétique

SECTION 6 – Revisions

PARTIE 6 – Révisions

Original / Originale	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
New Meter / Nouveau compteur	2019-07-23	Graeme Banks Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
1	2021-03-05	Eugen Axentii Legal Metrologist / Métrologiste légale
Purpose of Revision		But de la Révision
Legally non-relevant FlexNet software version 6.08 was released. Hardware updates were made due to certain component obsolescence.		La version du logiciel juridiquement non-pertinent 6.08 du FlexNet a été émise. Des mises à jour du matériel ont été effectuées en raison de l'obsolescence de certains composants.

SECTION 7 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

PARTIE 7 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Original document signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : 2021-03-05

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>