



**NOTICE OF APPROVAL**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

**AVIS D'APPROBATION**

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

Compressed Natural Gas Dispenser

**TYPE D'APPAREIL**

Distributeur de gaz naturel comprimé

**APPLICANT**

Kraus Global Ltd.  
 25 Paquin Road  
 Winnipeg, MB  
 R2J 3V9

**REQUÉRANT**

**MANUFACTURER**

Kraus Global Ltd.  
 25 Paquin Road  
 Winnipeg, MB  
 R2J 3V9

**FABRICANT**

**MODEL(S) / MODÈLE(S)**

SAM  
 DAM  
 HAM

**RATING / CLASSEMENT**

Maximum Capacity/Capacité maximale  
 Up to 50 kg/min (on all 3 approved models)

Note: Refer to the code sheet for approved series and options / Voir la feuille des codes du distributeur dans l'approbation pour les options



**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

## SUMMARY DESCRIPTION :

### Principle of Operation

The CNG dispensers deliver compressed natural gas to motor fuel vehicles.

The compressed natural gas is received via a single, double or three inlet banks. The gas passes through the Micro Motion mass flow meter, a solenoid valve, a cut-off valve, the delivery hose, then the nozzle. A relief valve is installed between the cut-off valve and nozzle. A needle valve is used to vent the hose when servicing is required. The Micon register controls the solenoid valves used for progressive filling in multi-bank installations and calculates a safe dispenser final fill pressure under all ambient temperature conditions. The maximum fill pressure is 3600 psi. The dispenser delivers on a basis of mass.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

## DESCRIPTION SOMMAIRE :

### Principe de fonctionnement

Ces distributeurs de GNC débitent le gaz naturel comprimé à des véhicules moteurs.

L'admission du gaz naturel comprimé s'effectue par une, deux ou trois canalisations. Le gaz passe dans le débitmètre massique Micro Motion, une électrovanne, un robinet d'urgence, le flexible, et puis par la buse. Une soupape de sécurité est installée entre le robinet d'urgence et la buse. Un robinet à pointeau est utilisé lorsque l'entretien est nécessaire. Le registre du débitmètre Micon commande les électrovannes de manière à assurer le remplissage graduel dans des installations à banques multiple, et calcule une pression de remplissage sécuritaire en fonction de la température ambiante. La pression de remplissage maximale est de 3600 lb/po<sup>2</sup>. Le distributeur débite sur une base de masse.



## Main Components

### Electronic Computer/Register Head

Kraus Micon 500 series electronic register  
model number Micon 500CN  
(Approved under AG-0409)

### Meter

Micro Motion CNG050 series mass flow meter  
model number CNG050S290NCAAEEZZZ

### Transmitter

Micro motion MVD 2000 series transmitter  
model number 2700I13ABAEZZZ

**Note:** Only the frequency output of the transmitter is approved for custody transfer.

## Configuration

Configuration of the Micro Motion transmitter is done through a Hart communicator or through a personal computer running Micro Motion ProLink II software. Adjustments to the dispenser are done by entering a calibration factor into the Micro Motion transmitter and not through the Kraus Micon 500CN head.

## Software/Firmware

### Transmitter; MVD 2000 series

The firmware version can be viewed using a model 275 HART communicator by selecting through the software menu: Review → Device information → Software version, or using the ProLink II software by clicking on “Installed Options” under the “View” menu. Approved firmware is identified as version:

- 3.7

## Éléments principaux

### Tête de calcul et d'indication électronique

Indicateur électronique Kraus Micon, série 500  
numéro de modèle Micon 500CN  
(approuvé en vertu d'AG-0409)

### Appareil de mesure

Débitmètre massique Micro Motion, série CNG050  
numéro de modèle CNG050S239NCAAEEZZZ

### Émetteur

Émetteur Micro Motion, série MVD 2000  
numéro de modèle 2700I13ABAEZZZ

**Note :** Seulement la fréquence de sortie de l'émetteur est approuvée pour les transferts fiduciaires.

## Configuration

La configuration de l'émetteur Micro Motion s'effectue au moyen d'un dispositif de communication Hart ou d'un ordinateur personnel configuré avec le logiciel Micro Motion ProLink II. Les réglages nécessaires au distributeur doivent être effectués en introduisant un coefficient d'étalonnage directement dans le transmetteur Micro Motion et non dans la tête du Kraus Micon 500CN.

## Logiciel/Micrologiciel

### Émetteur; série MVD 2000

Le numéro de version du micrologiciel peut être visionné au moyen d'un dispositif de communication Hart, modèle 275 en sélectionnant dans le menu logiciel : Review → Device information → Software version, ou en utilisant le logiciel ProLink II et en cliquant sur « Installed Options » dans le menu « View ». Le micrologiciel approuvé est identifié avec le numéro de version :

- 3.7



## Specifications

### Operating temperature range

Ambient (-40 to +55) °C  
(-40 to +131) °F

### Power Supply

Input Voltage (AC) 120 V, 60 Hz  
Maximum Power Consumption 100 W

### Inlet Gas Pressure (gauge)

Maximum Working 34 475 kPa (5000 psi)  
Maximum Allowable 24 820 kPa (3600 psi)

### Delivery Hose

The delivery hoses remain pressurized between fills.

## Caractéristiques

### Plage de températures de service

Ambiante (-40 à +55) °C  
(-40 à +131) °F

### Alimentation électrique

Tension d'entrée (c.a.) 120 V, 60 Hz  
Consommation d'électricité 100 W  
maximale

### Pression d'admission du gaz (mano)

Pression de service max. 34 475 kPa (5000 lb/po<sup>2</sup>)  
Pression admissible 24 820 kPa (3600 lb/po<sup>2</sup>)  
max.

### Flexible de distribution

Les flexibles demeurent pressurisés entre les remplissages.



**Code Sheet for the Dispenser / Feuille des codes du distributeur**

	Model	Series	Options
	SAM		
	DAM		
	HAM	- * C * G - P * * C * 1 * * * * *	
<u>Number of Inlet Lines / Nombre de canalisations d'admission</u>			
One / Une	1		
Two / Deux	2		
Three / Trois	3		
<u>Cabinet Style / Type d'enceinte</u>			
IMW-style		I	
High Style/Modèle haut		H	
High Style, Dual Front / Modèle haut; double face		F	
Low Style /Modèle bas		L	
Enclosure /Enceinte		E	
Gilbarco Style /Style Gilbarco		G	
<u>Meter / Compteur</u>			
Micro Motion CNG050		G	
<u>Temperature Compensation / Compensation de la température</u>			
PFS 3000 (Micon 500)			P
<u>Fill Pressure /Pression de remplissage</u>			
2400 psi (gauge) / 2400 lb/po <sup>2</sup> (mano)			2
3000 psi (gauge) / 3000 lb/po <sup>2</sup> (mano)			3
3600 psi (gauge) / 3600 lb/po <sup>2</sup> (mano)			6
3000/3600 psi (gauge) split / 3000/3600 lb/po <sup>2</sup> (mano) diviseur			S
<u>Flow Rate (Note: Limited to flow rate under the heading "Rating") / Débit (Note : Limité au débit indiqué à la rubrique «Classement »)</u>			
1000 SCFM			1
2000 SCFM			2
3500 SCFM			3
Split 2000/3500 SCFM			S
<u>Meter Approval / Approbation du compteur</u>			
CSA			C
<u>Interface / Interface</u>			
None/Aucun			0
RS232			2
Gilbarco 2-Wire			G
<u>Input Voltage (AC) / Tension d'alimentation (c.a.)</u>			
120 Volt / 120 V			1
<u>Nozzle (Side 1) / Buse (côté 1)</u>			
NGV 1, type 1 / VGN, type 1			1
NGV 1, type 2 / VGN, type 2			2
Bus Heavy Duty, Type 1 / Bus robuste, type 1			3
Bus Heavy Duty, Type 2 / Bus robuste, type 2			4
<u>Nozzle Manufacturer (Side 1) / Fabricant de la buse (côté 1)</u>			
Sherex/OPW			S
Staubli			B
WEH			W
Parker			P
Other (Oasis)			O
<u>Nozzle (Side 2) / Buse (côté 2)</u>			
None / Aucun			0
NGV 1, type 1 / VGN, type 1			1
NGV 1, type 2 / VGN, type 2			2
Bus/Heavy Duty, Type 1 / Bus robuste, type 1			3
Bus Heavy Duty, Type 2 / Bus robuste, type 2			4
<u>Nozzle Manufacturer (Side 2) / Fabricant de la buse (côté 2)</u>			
Sherex/OPW			S
Staubli			B
WEH			W
Parker			P
Other (Oasis)			O
<u>Regulator / Régulateur</u>			
None / Aucun			0
One Side / Une côté			1
Both Side / Deux côtés			2
<u>Nozzle / Buse</u>			
Customer Supplied / Fourni par le client			0
Kraus supplied / Fourni par Kraus			1



**Code Sheet for Micro Motion CNG050 Series Mass Flow Meter / Feuille des codes du débitmètre massique Micro Motion, série CNG050**

	CNG050S290NCAAEEZZZ
<u>Model</u> Micro Motion Coriolis CNG050S sensor; ½ inch; 316L stainless steel/Capteur Micro Motion CNG050S de type Coriolis, 1/2 po, 316 L, acier inoxydable	CNG050S
<u>Process Connection/Raccord</u> CAJON compatible size 12 VCO union fitting / Raccord-union VCO, grosseur 12, compatible CAJON	290
<u>Cabinet Style / Type d'enceinte</u> Standard/Standard	N
<u>Electronics Interface/Interface électronique</u> For integrally mounted 2700 transmitter (at time of purchase)/Pour émetteur 2700 intégré (au moment de l'achat)	C
<u>Conduit Connections/Raccords de canalisations</u> No gland (no conduit connections - integral mount 2700)/Sans manchon de raccordement (aucun raccord de canalisation - montage intégré 2700)	A
<u>Approvals/Approbations</u> CSA (USA and Canada)/CSA (É.-U. et Canada)	A
<u>Language/Langue</u> English/anglais	E
<u>Future Options/Options futures</u> Reserved for future options/Réservé pour des options futures	ZZ
<u>Factory Options/Options en usine</u> Standard Product/Produit standard	Z



**Code Sheet for Micro Motion MVD 2000 Series Transmitter / Feuille des codes de l'émetteur Micro Motion, série MVD 2000**

	Model	
Micro Motion multivariable flow and density transmitter/Émetteur Micro Motion pour débit et masse volumique multivariables	2700	2700 I 1 3 A B A E Z Z Z
Integral mount transmitter/Émetteur à montage intégré		I
18 to 30 VDC and 85 to 265 VAC; self-switching/18 à 30 V c.c. et 85 à 265 V c.a., commutation automatique		1
No display/Sans affichage		3
One mA; one frequency; RS-485/Un mA; une fréquence		A
½ inch NTP - no gland / ½ po filets NTP, sans manchon de raccordement		B
CSA (USA and Canada)/CSA (É.-U. et Canada)		A
English/Anglais		E
Flow and density variables (standard)/Variables d'écoulement et de masse volumique (standard)		Z
No software options 2/aucune option 2 pour le logiciel		Z
Standard Product/Produit standard		Z

**Marking**

The following information is on a nameplate attached to the dispenser:

- Manufacturer's name or registered trademark
- Model number
- Serial number
- Departmental approval number
- Nominal input voltage and frequency
- Nominal power consumption

The electronic computer/register head, the mass flow meter and the transmitter each have a nameplate showing the name of the manufacturer and model number.

**Marquage**

L'information suivant est sur la plaque signalétique fixée sur le distributeur :

- Le nom ou marque de commerce déposée du fabricant
- Le numéro de modèle
- Le numéro de série
- Le numéro d'approbation
- La tension d'entrée et fréquence nominales
- La puissance nominale

La tête de calcul/d'indication électronique, le débitmètre massique et l'émetteur chacun portent une plaque signalétique indiquant le nom du fabricant et le numéro de modèle.



## Sealing Provisions

### Mass Flow Meter

The meter is sealed to prevent removal from the dispenser using two 2-piece brackets: one on each end of the meter. These brackets are mounted to the frame and two holes have been drilled through both pieces of the bracket and the frame. The brackets are prevented from separation and from removal by passing a sealing wire through both of the holes and sealing with a lead seal. Refer to figure 5.

For dispensers with a Gilbarco style cabinet, the meter is sealed to prevent removal from the dispenser with two drilled-shank upper meter clamp bolts with nuts that have locking retainers installed. Sealing wire is threaded through both the bolt shank holes and nut retainers and sealed with a lead seal to prevent un-threading of the fasteners. Refer to figure 6.

### Transmitter

The end covers of the MVD 2000 series transmitter are sealed using a wire and seal through two drilled head bolts securing the end cap clamps (F-LOKS), one bolt and clamp for each cover. The software lock must be enabled using a personal computer, running the Micro Motion custody transfer software, connected to terminals 7 and 8. Refer to figure 4.

### Electronic Computer/Register Head

The Micon 500CN is sealed in accordance with the provisions under AG-0409.

## Dispositifs de Scellage

### Débitmètre massique

Le débitmètre est scellé, pour empêcher qu'il ne soit enlevé, au moyen de deux pattes de fixation, l'une à chaque extrémité du débitmètre. Ces pattes de fixation sont montées sur le bâti du débitmètre et deux trous ont été ménagés à travers les pattes et le bâti. Les pattes sont assujetties au moyen d'un fil métallique passé à travers les trous lequel est ensuite scellé au moyen d'un plomb. Voir la figure 5.

Pour les distributeurs avec une enceinte Gilbarco, le débitmètre est scellé, pour empêcher qu'il ne soit enlevé, avec deux boulons de serrage à queue percée du compteur supérieure avec des écrous qui ont des retenues à verrouillages installés. Du fil métallique est passé à travers les trous des boulons et des retenues d'écrou, et est ensuite scellé au moyen d'un plomb. Voir la figure 6.

### Émetteur

Les couvercles d'extrémité de l'émetteur MVD de série 2000 sont scellés au moyen d'un sceau et d'un fil métallique passant à travers deux boulons à tête percée assujettissant les attaches des couvercles d'extrémité constituées d'un boulon et d'une bride pour chaque couvercle. La protection par programme doit être activée à l'aide de l'ordinateur personnel configuré avec le logiciel de transfert fiduciaire Micro Motion, connecté aux bornes 7 et 8. Voir la figure 4.

### Tête de calcul/d'indication électronique

Le Micon 500CN est scellé conformément à l'AG-0409.



## Revisions

### Original (2007-02-15)

#### **AG-0544 Rev. 1** (2009-07-03)

The purpose of this revision is to add the IMW style cabinet and RS232 interface options as shown in the dispenser's code sheet.

#### **AG-0544 Rev. 2** (2014-12-01)

The purpose of this revision is to increase the maximum capacity from 10 kg/min to 50 kg/min and allow for fill pressures up to 3600 psi. MAL-G340 was incorporated into this revision and the "Principle of Operation" section was generalized.

#### **AG-0544 Rev. 3** (2015-01-29)

The purpose of this revision was to clarify the maximum capacity of all models, add non-metrological changes to the code sheet, and to incorporate MAL-G345.

#### **AG-0544 Rev. 4** (2016-06-28)

The purpose of this revision is to add a secondary sealing method for the mass flow meter for dispensers with a Gilbarco style cabinet. MAL-G347 was incorporated into the NOA. The 'Principle of Operation' and 'Marking Requirements' sections have been revised.

## Révisions

### Original (2007-02-15)

#### **AG-0544 Rév. 1** (2009-07-03)

Le but de cette révision est d'ajouter les options suivantes: cabinet de type IMW et interface RS232 montré dans la feuille des codes du distributeur.

#### **AG-0544 Rév. 2** (2014-12-01)

Le but de cette révision est d'augmenter la capacité maximale de 10 kg/min à 50 kg/min, et de permettre des pressions de remplissage de 3600 psi. La LAM-G340 a été incluse dans cette révision, et la section « Principe de fonctionnement » a été généralisée.

#### **AG-0544 Rév. 3** (2015-01-29)

Le but de cette révision est de clarifier la capacité maximale de tous les modèles, de faire des précisions sur la feuille des codes du distributeur, et d'inclure la LAM-G345.

#### **AG-0544 Rév. 4** (2016-06-28)

Le but de cette révision est d'ajouter une deuxième méthode pour le scellage du débitmètre massique pour les distributeurs avec une enceinte Gilbarco. La LAM-G347 a été incluse dans cet approbation. Les sections de principe de fonctionnement et d'exigences de marquage ont été révisées.



Measurement  
Canada

An Agency of  
Industry Canada

Mesures  
Canada

Un organisme  
d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

**AG-0544 Rev. 4**

## **Evaluated By**

### Original and Rev. 2

Ed DeSousa  
Senior Legal Metrologist

### Rev. 1

Randy Byrtus, CET  
Manager, Gas Laboratory

### Rev. 3

Joël Guindon  
Manager, Gas Laboratory

### Rev. 4

Adam Falicki  
Junior Legal Metrologist

## **Évalué Par**

### Original et Rév.2

Ed DeSousa  
Métrologiste légal principal

### Rév. 1

Randy Byrtus, T.S.A.I.  
Gestionnaire, Laboratoire de gaz

### Rév. 3

Joël Guindon  
Gestionnaire, Laboratoire de gaz

### Rév. 4

Adam Falicki  
Métrologiste légal junior



Photographs and Diagrams / Photographies et diagrammes

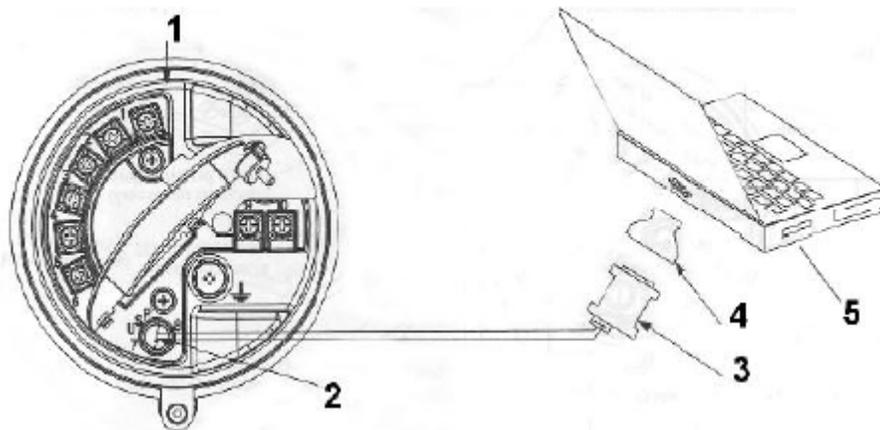


**Figure 1.** Kraus Global SAM Series High Style CNG dispenser / Distributeur de gaz naturel comprimé Kraus Global: série SAM, modèle haut

**Figure 2.** Kraus Global CNG dispenser with Gilbarco Encore 500 cabinet / Distributeur de gaz naturel comprimé Kraus Global avec l'enceinte 'Encore 500' de Gilbarco

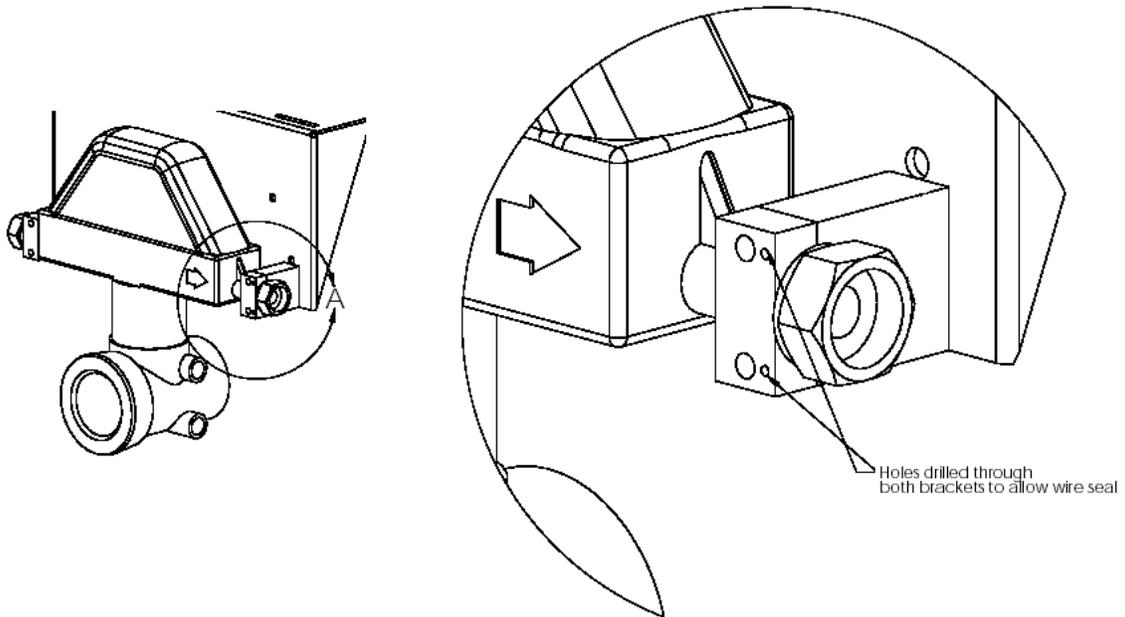


**Figure 3.** The Micro Motion CNG050 Series mass flow meter with the 2000 series transmitter / Débitmètre massique Micro Motion, série CNG050 avec émetteur série 2000



1. MVD 2700 terminal compartment/Compartiment du terminal MVD 2700
2. USP terminals 7 and 8/Bornes 7 et 8 USP
3. RS-485 to RS-232 converter/Convertisseur RS-485 à RS-232
4. 25 to 9 pin serial port adapter/Adaptateur de port série de 25 à 9 broches
5. Personal Computer/Ordinateur personnel

**Figure 4.** Personal Computer connecting to MVD 2700 Service Port / Ordinateur personnel se connectant au port de service du MVD 2700



**Figure 5.** Sealing provision for the mass flow meter /Scellage du débitmètre massique



**Figure 6.** Sealing provision for the mass flow meter for dispensers with a Gilbarco style cabinet / Scellage du débitmètre massique pour les distributeurs avec une enceinte Gilbarco



Measurement  
Canada

An Agency of  
Industry Canada

Mesures  
Canada

Un organisme  
d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

**AG-0544 Rev. 4**

## APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the *Regulations*. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

## Original copy signed by :

Christian Lachance, P.Eng.  
Senior Engineer – Gas Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

## APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ont été évalués conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. La présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

## Copie authentique signée par :

Christian Lachance, P.Eng.  
Ingénieur principal – Mesure des gaz  
Direction de l'ingénierie et des services de  
laboratoire

Date: **2016-06-29**

Web Site Address / Adresse du site Internet:



Measurement  
Canada

An Agency of  
Industry Canada

Mesures  
Canada

Un organisme  
d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

**AG-0544 Rev. 4**

<http://mc.ic.gc.ca>