



Industry and Science
Canada

Legal Metrology

Industrie et Sciences
Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

AM-5049

MAR 21 1995

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry,
Science and Technology for:

CATEGORY OF DEVICE:

Electronic Computing Scale

APPLICANT / REQUÉRANT:

TEC Canada Inc.
370 Britannia Road East, Unit #1
Mississauga, Ontario
L4Z 1X9

MODEL(S) / MODÈLE(S):

SL-9000-15M-FFB-CA

RATING / CLASSEMENT:

0 - 6 kg x 0.002 kg
6 - 15 kg x 0.005 kg Multi-Interval / échelons multiples
or/ou
0 - 15 lb x 0.005 lb
15 - 30 lb x 0.01 lb Multi-Interval / échelons multiples

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, pour:

CATÉGORIE D'APPAREIL:

Balance calculatrice électronique

MANUFACTURER / FABRICANT:

P.T. TEC Indonesia
Lot 108 Batam Industrial Park
Muka, Kuning, Batam,
Indonesia

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

CATEGORY

The device is an electronic multi interval programmable computing scale with an integral printer.

DESCRIPTION

The base frame is constructed from cast aluminum and can be levelled by means of four adjustable locking feet and a bullseye level.

A single 30 kg load cell, centrally mounted on the base of the device, accommodates a load spider and a 240 mm x 380 mm stainless steel platter. The device is encased in a plastic enclosure and incorporates a keyboard.

INDICATOR

The pole-mounted dual operator/customer display is bolted to the back section of the device. The display is of the fluorescent full dot matrix type with indications for ENTER PLU, lb., kg, PRICE, ZERO, PRE-PACK, 100g and MAIN MENU.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

CATÉGORIE

Il s'agit d'une balance calculatrice électronique programmable à échelons multiples munie d'une imprimante intégrée.

DESCRIPTION

Le socle est en aluminium coulé et peut être mis au niveau à l'aide de quatre pieds réglables et verrouillables et d'une bulle de mise au niveau.

Une seule cellule de pesage d'une capacité de 30 kg centrée sur le socle soutient un support araignée et un plateau en acier inoxydable de 240 mm x 380 mm. L'appareil est abrité dans un boîtier en plastique et comprend un clavier.

INDICATEUR

Le dispositif d'affichage double opérateur/client monté sur colonne est boulonné au dos de l'appareil. Il est à matrice par points et de type fluorescent et comporte des voyants pour ENTER PLU, lb, kg, PRICE, ZERO, PRE-PACK, 100 g et MAIN MENU.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**FUNCTION KEYS**

The operator controls are in two sections and consist, among others, of:

A) A block of keys which includes:

- 0-9 - numeric keys 0 to 9, used to enter PLU Number, Unit Price and Tare Weight.
- C - Clear Key used to clear or cancel PLU and Price entries. This key is also used to change the device from the Save mode to Regular mode.
- T - used to set a tare weight.
- SAVE - used to save Tare and Unit Price after removing the commodity from the platter.
- POWER - used to power the device OFF/ON.
- 100 g kg - used to change Unit Price (per 100g or kg).

B) PROGRAMMING KEYS

- CLEAR - used to clear numeric entries prior to the depression of another function key and also to change the device from an Error mode.
- ENTER - used during programming to input data.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**TOUCHES FONCTIONS**


Les commandes de l'opérateur sont en deux sections et se composent, notamment:

A) du bloc de touches suivantes:

- 0-9 - les touches numériques 0 à 9 pour entrer le numéro PLU, le prix unitaire et la tare;
- C - la touche Clear pour effacer ou annuler les entrées de PLU et du prix. Elle sert aussi à faire passer l'appareil du mode sauvegarde au mode normal;
- T - cette touche sert à entrer une tare;
- SAVE - cette touche sert à sauvegarder la tare et le prix unitaire après le retrait du produit du plateau;
- POWER - cette touche sert à mettre l'appareil sous tension et hors tension;
- 100 g kg - cette touche sert à changer le prix unitaire (par 100 g ou par kg);

B) des touches de programmation suivantes:

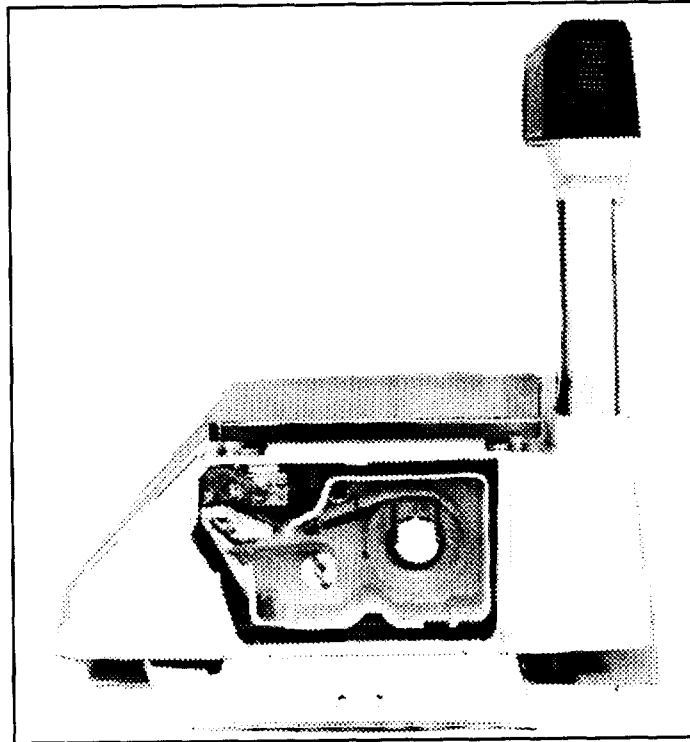
- CLEAR - cette touche sert à effacer les entrées numériques avant d'enfoncer une autre touche fonction et aussi à ramener l'appareil d'un mode erreur;
- ENTER - cette touche est utilisée pendant la programmation pour entrer des données.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****MODEL / modèle SL9000****SEALING**

The ZERO and SPAN adjustments are located under the platter of the device and can be sealed with a combination of wire and lead seal and a tamper proof seal. The design is exempted from providing ready access to all other components or adjustments without breaking a seal as specified in SGM 1/12.

SCELLAGE

Les dispositifs de réglage du ZÉRO et de la PORTÉE se trouvent sous le plateau de l'appareil qui peut être scellé à l'aide d'un fil métallique et d'un plomb et d'un scellé infraudable. L'appareil n'est pas tenu d'assurer un accès facile à tous les autres composants ou dispositifs de réglage sans bris de scellé conformément à la norme SGM 1/12.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****SIDE VIEW / vue de côté****EVALUATED BY:**

Milton Smith
Complex Approval Technologist
Tel. (613) 952-0656
Fax. (613) 952-1754

ÉVALUÉ PAR:

Milton Smith
Technologue, approbations complexes
Tél: (613) 952-0656
Fax: (613) 952-1784

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.


The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Robert C. Bruce
Director, Weights and Measures

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.


Robert C. Bruce
Directeur, Poids et Mesures

Date: MAR 21 1995