



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Electricity Meter: Energy and Demand

TYPE D'APPAREIL

Compteur d'électricité : énergie et maximum

APPLICANT

Schlumberger Canada Limited
4005 rue Bellefeuille
Trois-Rivières, Québec
G9A 5J3

REQUÉRANT

MANUFACTURER

SchlumbergerSema
313-B North Highway 11
P.O. Box 75
West Union, SC 29696
USA

FABRICANT

MODEL(S)/MODÈLE(S)

CENTRON
C1S CN1S
C1SD CN1SD
C1SL CN1SL
C1SR CN1SR
C1ST CN1ST
C1ST W/R300CD CN1ST WR/300CD
C1X

RATING/ CLASSEMENT

120, 240V (ac)/(c.a.)
0.2-20, 1-100, 2-200 amperes/ampères
0.25-100, 0.5-200 amperes/ampères
60 Hz
1.5 element, 3 wire, single-phase/1,5 élément, 3 fils, monophasé
1 element, 2 wire, single-phase/1 élément, 2 fils, monophasé
2 element, 3 wire, network/2 élément, 3 fils, réseau

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The Centron meter is a bi-directional, solid state self-contained meter approved for revenue metering.

The Centron meter is approved for measurement of kW•h.

The Centron meter is approved for block interval and sliding window kW demand.

The Centron meter is approved for time-of-use metering (kW•h).

The meter has an optional internal pulse recorder.

PHYSICAL DESCRIPTION

The meter has a glass or polycarbonate transparent cover. The front of the meter has a liquid crystal display (LCD) or a mechanical register driven by a stepping motor to display the energy value.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le Centron est un compteur autonome à semi-conducteurs approuvé aux fins de facturation.

Le Centron est approuvé pour mesurer les kW•h

Le Centron est approuvé pour le mesurage de la puissance (kW), de type période d'intégration et à fenêtre mobile.

Le Centron est approuvé pour le mesurage à tarif horaire (kW•h).

Le compteur a un enregistreur d'impulsion facultatif.

DESCRIPTION PHYSIQUE

Le compteur possède un couvercle en verre ou polycarbonate transparent. Le devant du compteur présente un dispositif d'affichage à cristaux liquides (CL), ou un registre mécanique entraîné par un moteur pas-à-pas, qui sont destinés à afficher les valeurs énergétiques

The electronic register is protected by a molded plastic cover. This module is attached to the meter frame. The register housing holds the circuit board which contains the microprocessor, liquid crystal display (LCD), nonvolatile memory, time keeping circuits, optical pick-up circuitry, and power supply circuits.

Features located on the electronic module are the test operating mode switch, alternate display mode magnetic reed switch, and the demand reset button.

Meters intended for time-of-use metering shall be fitted with a lithium battery. Demand is not approved for time-of-use.

When the feature requires it, the cover is equipped with an optical port and demand reset mechanism.

A LED (Wh pulse) is located on the top of the meter for testing purposes.

The meter is available as a socket base (S-base).

PROGRAMMING

All programming for the Centron is done in factory.

All extended functions versions of the CENTRON are programmable by means of the Schlumberger PC PRO+ Software and a PC.

The software is password protected.

The meter can be programmed via the optical port which is located on the face of the electronic register.

L'élément indicateur électronique est protégé par un couvercle en plastique moulé. Il est attaché au bâti du compteur. Le logement de l'élément indicateur renferme la carte imprimée qui contient le microprocesseur, l'affichage à cristaux liquides (CL), la mémoire rémanente, les circuits d'horloge, les circuits de détection optique et les circuits d'alimentation.

Les commandes situées sur le module électronique sont le sélecteur de mode d'essai, l'interrupteur à lames de mode d'affichage spécial et le bouton de mise à zéro de la puissance.

Les compteurs prévus pour le mesurage à tarif horaire doivent être équipés d'une pile au lithium. Le mesurage de la puissance maximum n'est pas approuvé pour le tarif horaire.

Lorsque requis par les fonctions avancées le couvercle possède un port optique et un mécanisme de remise à zéro de la puissance.

Une DÉL (clignotement par Wh) se trouve à la partie supérieure du compteur à des fins d'essai.

Le compteur présente un socle à prise (type S).

PROGRAMMATION

Toute la programmation du Centron est effectuée en usine.

Tout les compteurs équipés de fonctions avancées sont programmable en utilisant le logiciel PC PRO+ de Schlumberger et un ordinateur.

Le logiciel est protégé par un mot de passe.

Les compteurs peuvent être programmé en utilisant le port optique qui est situé sur la face du registre électronique.

A meter with time-of-use function shall display the following items while the meter is operating in its normal mode:

- S the current date and time in the all numeric SI format i.e., YY/MM/DD/HH/MM. or other formats in which the name of the month(or a three letter abbreviation) and four digits for the year are used;
- S which register is currently engaged; and
- S the registration of each time-of-use register engaged in the current season.

The sequence of display, annunciators, and ID code numbers are selected during the programming process.

Programming includes the following;

- a) register displays and format;
- b) self-read data
- c) past season registers,
- d) display scroll time,
- e) cold load pickup time (demand after a power outage),
- f) demand interval lengths,
- g) sub-intervals,
- h) register full scale, and
- i) output pulses per disk revolution.

Programming for time-of-use metering includes the following;

- 1) Calendar schedule,
- 2) Rate schedule,
- 3) Daily schedule,
- 4) Seasonal schedule,
- 5) Holiday schedules,
- 6) Daylight savings time, and
- 7) Present and previous seasons.

Un compteur avec un tarif horaire affichera les quantités suivantes lorsque le compteur est dans son mode de fonctionnement normal:

- S la date du jour et l'heure dans le format de SI numérique c.-à-d., AA/MM/JJ/HH/MM ou d'autres formats dans lesquels le nom du mois(ou une abréviation de trois lettres) et quatre chiffres pour l'année sont utilisés;
- S le registre actuellement engagé; et
- S l'enregistrement de chaque registre de tarif horaire engagé dans la saison actuelle.

La séquence d'affichage, les voyants et les codes d'identification sont sélectionnés lors de la programmation.

La programmation porte sur les paramètres suivants :

- a) affichage et format des éléments indicateurs;
- b) données d'auto-lecture;
- c) éléments indicateurs de saison passée;
- d) temps de défilement de l'affichage;
- e) temps de détection de charge à froid (puissance après une panne de courant);
- f) durée des périodes d'intégration de puissance;
- g) sous-périodes d'intégration;
- h) valeur maximale des éléments indicateurs;
- i) impulsion de sortie par révolution de disque.

La programmation du mesurage à tarif horaire porte sur les paramètres suivants :

- 1) Tarif selon le calendrier;
- 2) Tarif à prix unitaire;
- 3) Tarif journalier;
- 4) Tarif saisonnier;
- 5) Tarifs des jours fériés;
- 6) Heure avancée;
- 7) Saisons actuelle et passée.

Configuration

Model(s) Modèle(s)	Voltage Tension	Current Courant	Element(s) Élément(s)	Connection Raccordement
C1S	120	1-100 0.25-100	1	Socket 4 blades self-contained Socle 4 lames autonome
	120	0.2-20	1	Socket 5 blades transformer type Socle 5 lames type transformateur
	240	0.2-20	1	Socket 5 blades transformer type Socle 5 lames type transformateur
	240	0.2-20	1,5	Socket 6 blades transformer type Socle 6 lames type transformateur
	240	2-200 0.5-200	1,5	Socket 4 blades self-contained Socle 4 lames autonome
CN1S	120	2-200 0.5-200	2	Socket 5 blades self-contained network Socle 5 lames autonome réseaux

Mechanical Register/Régitre Mécanique

Designation Appellation	Description	Function Fonction
Default Par défaut	Clock Dial, 5 Digits, Mult × 1 / Minuterie à cadran, 5 Chiffres, Mult × 1	Energy énergie
	Clock Dial, 4 Digits, Mult × 10 / Minuterie à cadran, 4 Chiffres, Mult × 10	
	Cyclometer, 5 Digits, Mult × 1 / Minuterie à tambour, 5 Chiffres, Mult × 1	
	Cyclometer, 4 Digits, Mult × 10 / Minuterie à tambour, 4 Chiffres, Mult × 10	

Electronic Register/Régitre Électronique **Liquid Crystal Display / Affichage à cristaux liquides**

Default Par défaut	5 Digits Mult × 1 / 5 chiffres Mult × 1	Energy énergie
	4 Digits Mult × 10 / 4 chiffres Mult × 10	
D	Programmable	Energy / Demand énergie / puissance
T	6 Digits/Decimal point/Watt, kW, MW Programmable	Energy/Time-of-use /Demand énergie/tarif horaire /puissance
L	6 chiffres/point decimal/Watt, kW, MW	Energy/Time-of-use /Demand/Recorder énergie/tarif horaire /puissance/enregistreur
R	Electronic register with a radio frequency module Régistre électronique avec un module radio fréquence	R300
	Electronic register with extended function and radio frequency module Régistre électronique avec fonctions avancées et module radio fréquence	W/R300CD

The “X” suffix indicates that the Centron meter is retrofitted with an approved automatic meter reader (AMR)

THEORY OF OPERATION

The meter is based on the Hall effect. Internal to the meter, a resistor is placed in series to create a current that is applied to the Hall cell.

The line current is used to create a magnetic field that flows through the Hall cell at right angles. The voltage output formed on the Hall cell device is proportional to the input watts.

All register types can be interchanged on all Centron models, provided that all connections are compatible.

MODES OF OPERATION

Meters fitted with an extended function electronic module have two modes of operations;

- 1) Normal operating mode and
- 2) Test operating mode

Normal Operating Mode

This is the default mode of operation in which the meter operates when power is applied to the meter. This mode is intended for actual in-service conditions and is programmed to display metrological parameters.

a) Normal Display Sequence:

The normal display sequence and alternate display sequence operate in this mode.

L’indicatif “X” signifie que le compteur Centron est équipé d’un système de télé-mesurage (AMR) approuvé.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le compteur fonctionne selon l’effet Hall. À l’intérieur du compteur se trouve une résistance placée en série de façon à créer un courant appliqué à la cellule Hall.

Le courant de ligne sert à créer un champ magnétique qui passe dans la cellule Hall à angle droit. La tension de sortie de la cellule Hall est proportionnelle aux watts d’entrée.

Tous les types d’afficheur peuvent être interchangés sur tous les modèles des produits Centron, si les raccordements le permettent.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Les compteurs équipés de module électronique avec fonctions avancées ont deux modes de fonctionnement;

- 1) Mode de fonctionnement normal et
- 2) Mode de fonctionnement d’essai

Mode de fonctionnement normal

Il s’agit du mode de fonctionnement implicite, dans lequel le compteur fonctionne lorsqu’il est mis sous tension. Ce mode est prévu pour les conditions réelles de fonctionnement et est programmé pour afficher les paramètres métrologiques.

a) Séquence d’affichage normale

Le mode de fonctionnement normal permet la séquence d’affichage normale et la séquence d’affichage spéciale.

In the normal display sequence the following items are found;

- 1) Energy
- 2) Max demand
- 3) Cumulative demand

For the meters with the time of use function:

- 1) current date and time
- 2) currently engaged register (Will blink on and off)
- 3) registration of each time of use register engaged in the current season.

b) Alternate Display Sequence

The alternate display sequence is intended for utility use.

The alternate display sequence is activated when the meter is in the normal operating mode by means of passing a magnet across the magnetic reed switch or by means of software.

The reed switch is hidden from view near the 10 o'clock position as viewed from the front.

The alternate display sequence will scroll once through the displayable items and automatically return to the normal display sequence.

Test Operating Mode

Meters fitted with an extended function electronic module can be put into test operating mode by means of the Test Mode switch located on the front of the electronic module under the meter cover.

A flashing annunciator, "TEST", will appear in the lower left hand corner of the display.

The purpose of this mode is to provide a convenient means of testing the accuracy of the demand function.

In test mode operation the demand interval is reduced

Dans la séquence d'affichage normale on retrouve les quantités suivantes;

- 1) énergie
- 2) puissance maximum
- 3) puissance maximum cumulative

Pour les compteurs équipés du tarif horaire:

- 1) la date et l'heure actuel
- 2) le registre actuellement engagé (Clignote lors que actif)
- 3) l'enregistrement de chaque registre tarifaire activé dans la saison actuel.

b) Séquence d'affichage spéciale

La séquence d'affichage spéciale est destinée à l'utilisation par la compagnie d'électricité.

On lance la séquence d'affichage spéciale lorsque le compteur est en mode de fonctionnement normal en passant un aimant par-dessus l'interrupteur à lames ou au moyen du logiciel.

L'interrupteur à lames n'est pas visible et est situé à peu près à la position 10 heures, l'observateur étant placé devant l'appareil.

La séquence d'affichage spéciale fait défiler une fois les articles affichables, puis revient automatiquement à la séquence d'affichage normale.

Mode de fonctionnement d'essai

Les compteurs équipés de module électronique avec fonctions avancées peuvent être mis en mode de fonctionnement d'essai au moyen de l'interrupteur de mode d'essai situé sur l'avant du module électronique, sous le couvercle du compteur.

Un annonceur TEST clignote alors au coin gauche inférieur de l'affichage.

Ce mode offre un moyen commode de vérifier la précision des fonctions de mesurage d'énergie et de puissance.

to 3 minutes in order to facilitate accelerated testing of

the demand function.

The test mode is approved for the purpose of verifying the performance and accuracy of energy and demand measurement functions which have been approved as legal units of measurement in this notice of approval.

An automatic time out of the test mode can be programmed for the module.

INDICATORS

One infrared test LED is located at the top of meter (as viewed from the front).

SEALING

The meter is sealed in the same manner as all S-base meters.

MODEL NUMBER SUFFIX

The C1S is a single phase (S-base), solid-state meter approved for measuring energy (kWh). It can have the mechanical or the electronic register.

The C1SR is the same as the CS1 but contains a R300 radio frequency module.

The C1SD is a single phase (S-base), solid-state meter approved for measuring energy and demand.

The C1ST is a single phase (S-base), solid-state meter approved for energy, demand, and time of use.

The C1SL is a single phase (S-base), solid-state meter approved for measuring energy, demand, time of use, and pulse recording.

Lorsque le mode d'essais est en fonction l'intervalle d'intégration est réduite à 3 minutes afin de faciliter l'essais de la fonction de puissance.

Le mode d'essai est approuvé aux fins de la vérification de la performance et de la précision des fonctions de mesure d'énergie et de puissance qui ont été approuvées comme unités de mesure légales dans le présent avis d'approbation.

Une fin automatique du mode d'essai peut être programmée pour le module.

INDICATEURS

Une DÉL d'essai se trouve à la partie supérieure du compteur (vue de l'avant).

SCELLAGE

Le compteur est scellé de la même façon que tous les compteurs à socle S.

SUFFIXE DU NUMÉRO DE MODÈLE

Le C1S est un compteur monophasé (à socle S) à circuits intégrés approuvé aux fins de mesurage de l'énergie (kWh). Il peut être muni du registre électronique ou du registre mécanique.

Le registre électronique du C1SR renferme un module radio-fréquence R300.

Le C1SD est un compteur monophasé (à socle S) à circuits intégrés approuvé aux fins de mesurage de l'énergie et la puissance.

Le C1ST est un compteur monophasé (à socle S) à circuits intégrés approuvé aux fins de mesurage de l'énergie, la puissance et du mesurage à tarif horaire.

Le C1SL est un compteur monophasé (à socle S) à circuits intégrés approuvé aux fins de mesurage de l'énergie, la puissance, mesurage à tarif horaire et pour l'enregistrement d'impulsions.

The C1SD, C1ST, and the C1SL are approved for block and sliding window demand.

The CN1S is the same as the C1S but with a network configuration.

The CN1SD is the same as the C1SD but with a network configuration.

The CN1ST is the same as the C1ST but with a network configuration.

The CN1SL is the same as the C1SL but with a network configuration.

The CN1SR is the same as the C1SR but with a network configuration.

SPECIFICATIONS

Operating temperature: Approved - 40°C to +53°C
 Manufacturer's range: - 40°C to +85°C

REVISION

Rev. 1

The purpose of Revision 1 was to include the use of the mechanical register.

Rev. 2

The purpose of revision 2 was to include the 100 amp rating and the cyclometer register.

Rev. 3

The purpose of revision 3 was to include a liquid crystal display, 4 digits, mult × 10 for energy function. It was also to include a network meter.

Le C1SD, C1ST, et le C1SL sont approuvés pour le mesurage de puissance à période d'intégration et à fenêtre mobile.

Le modèle CN1S est le même que le C1S mais est un compteur à réseau.

Le modèle CN1SD est le même que le C1SD mais est un compteur à réseau.

Le modèle CN1ST est le même que le C1ST mais est un compteur à réseau.

Le modèle CN1SL est le même que le C1SL mais est un compteur à réseau.

Le modèle CN1SR est le même que le C1SR mais est un compteur à réseau.

CARACTÉRISTIQUES

Températures de service: Approuvées - 40 à +53°C
 Plage du fabricant: - 40 à +85°C

RÉVISION

Rév. 1

La révision 1 visait à inclure le registre mécanique.

Rév. 2

La révision 2 visait à inclure la gamme de 100 ampères et la minuterie à tambours.

Rév. 3

La révision 3 visait à inclure un affichage à cristaux liquides, 4 chiffres avec un multiplicateur de 10, pour la fonction d'énergie. Elle visait aussi à inclure un compteur réseau.

Rev. 4

The purpose of revision 4 was to include a mechanical register display, 4 digits, mult $\times 10$ for energy function. It was also to include a demand meter, a time of use meter, and a pulses recorder.

Rev. 5

The purpose of revision 5 was to include a cyclometer register display, 4 digits, mult $\times 10$ for energy function.

Rev. 6

The purpose of revision 6 was to include transformer type (0.2-20 A) meter and the models CN1SD, CN1SL, CN1SR, CN1ST, C1ST W/R300CD and CN1ST WR/300CD.

Rev. 7

The purpose of revision 7 was to include extended current range 0.25-100 and 0.5-200A, also to re-include the cyclometer, 5 Digits, Multiplier $\times 1$.

Rev 8

The purpose of revision 8 is to include the bi-directional measurement of energy and demand and to include a newer liquid crystal display. Reference to approved the load profil function has been removed.

Rév. 4

La révision 4 visait à inclure un registre mécanique, 4 chiffres avec un multiplicateur de 10 pour la fonction énergie. Elle visait aussi à inclure le mesurage de la puissance, du tarif horaire, et l'enregistrement d'impulsions.

Rév. 5

La révision 5 visait à inclure une minuterie à tambours, à 4 chiffres avec un multiplicateur de 10 pour la fonction énergie.

Rév. 6

La révision 6 visait à inclure les compteurs à type transformateur (0,2-20 A) et le modèles CN1SD, CN1SL, CN1SR, CN1ST, C1ST W/R300CD et CN1ST WR/300CD.

Rév. 7

La révision 7 visait à inclure la gamme de courant étendu de 0,25-100 et 0.5-200A et réintroduire la minuterie à tambour, 5 chiffres avec un multiplicateur $\times 1$.

Rév. 8

La révision 8 vise à inclure le mesurage bi-directionnel des fonctions énergie et puissance, à inclure un nouvel affichage à cristaux liquides. Les références à l'approbation de l'enregistreur de charge ont été retiré.

EVALUATED BY

Fred Bissagar, Original, Rev.1, 2 and 7
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 941-4610
Fax: (613) 952-1754

Alain Gagné, Rev.3, 4, 5 and 6
Approvals Examiner
Tel: (613) 952-2259
Fax: (613) 952-1754

ÉVALUÉ PAR

Fred Bissagar, original, Rév.1, 2 et 7
Examinateur d'approbations complexes
Tél: (613) 941-4610
Fax: (613) 952-1754

Alain Gagné, Rév.3, 4, 5 et 6
Examinateur d'approbations
Tél: (613) 952-2259
Fax: (613) 952-1754



Centron C1S
Energy only
Énergie seulement



C1S
Clock dial ×1
Minutrie à cadran ×1



C1S
Cyclometer ×1
Minuterie à tambours ×1



C1S
Liquid crystal display
Affichage à cristaux liquides



C1S
Clock dial Mult ×10
Minuterie à cadran Mult ×10




C1SL
Pulses recorder
Enregistreur d'impulsions




C1SD
Demand
Puissance maximum




C1ST
Time-of-use
Tarif horaire

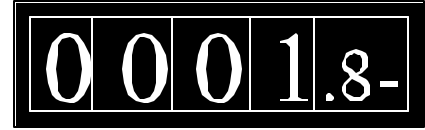

C1S
Cyclometer ×10
Minuterie à tambour × 10

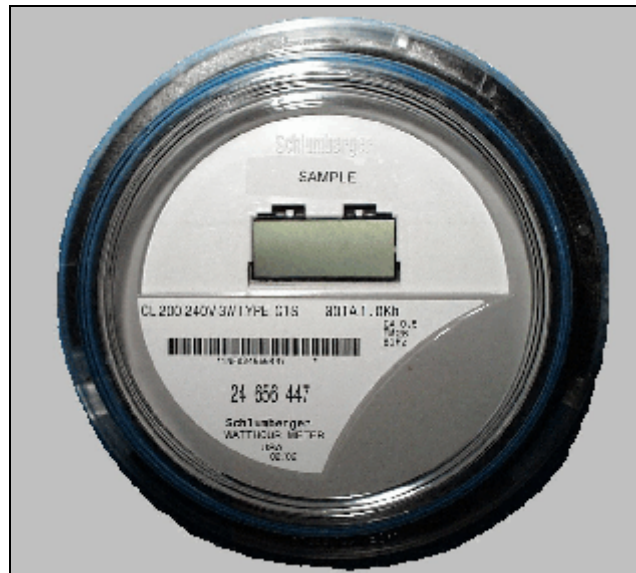

C1S
New Liquid crystal
Nouvel affichage à cristaux liquides

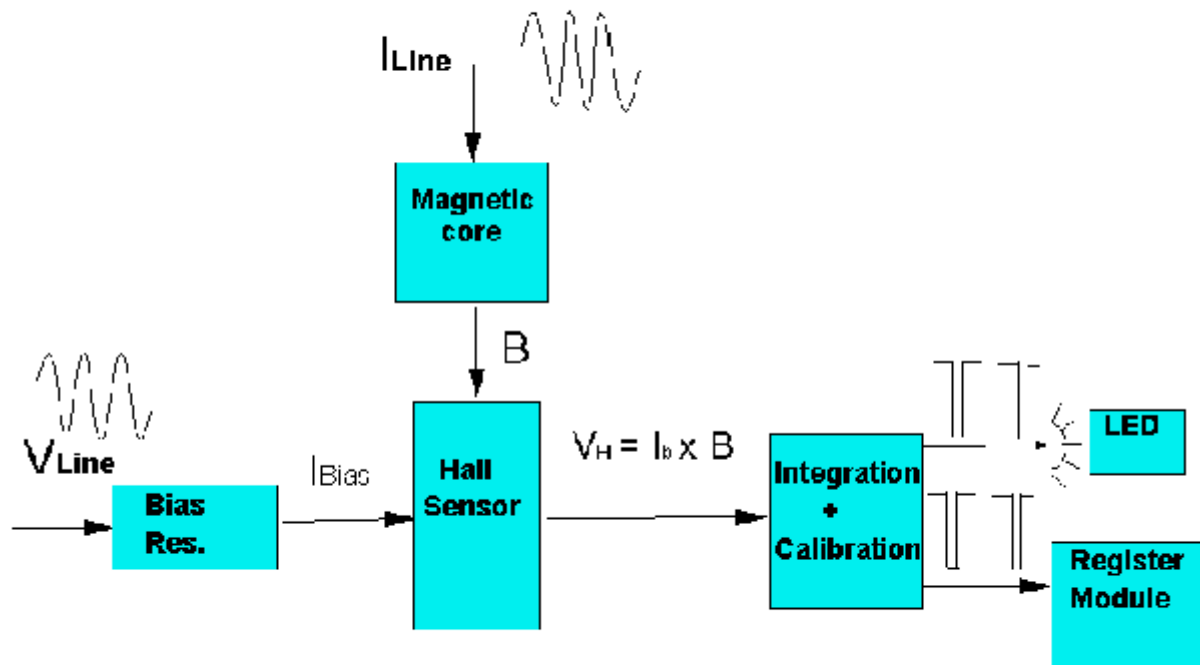

Bloc
Diagr
Schéma fonctionnel

k
a m /

2. Line current (I_{line})/courant de ligne
3. Line voltage (V_{Line})/tension de ligne
4. Bias current I_{Bias} /courant abaisser
5. Magnetic core/tore magnétique
6. Bias resistance/résistance du diviseur de tension
7. Hall sensor/capteur Hall
8. Integration/intégration
9. Calibration/calibration
10. Light emitting diode (LED)/diode électroluminescente
11. Register module/module d'affichage

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Original signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Copie authentique signée par:

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **MAR 21 2003**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>