



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour :

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Electronic Pulse Recorder

Enregistreur électronique d'impulsions

APPLICANT

REQUÉRANT

Metretek Incorporated
305 East Drive, Suite A
Melbourne, Florida, 32904
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

Mercury Instruments
3940 Virginia Ave.
Cincinnati, Ohio, 45227
USA

Previously manufactured by
Metretek Incorporated
305 East Drive, Suite A
Melbourne, Florida, 32904
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

SIP-CB Data Logger Series /
Enregistreur de données Séries SIP-CB

Form A or C pulse inputs /
Entrées d'impulsions (forme A ou C)

2001-0195-005 (4 channels / voies)
2001-0198-001 (4 channels / voies)
2001-0198-002 (4 channels / voies)
2001-0198-003 (4 channels / voies)
2001-0195-006 (2 channels / voies)

Maximum input frequency 10 Hz /
Fréquence maximale de 10 Hz

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The SIP-CB (Survey Instrument Point - Cellular/Battery) Data Logger counts the pulses from an approved gas meter equipped with an integral pulse output or with an external approved pulse transmitting device that represents gas volume. The pulse count is stored at configurable intervals, ranging from 1 to 60 minutes. At scheduled times or on demand, the SIP-CB Data Logger establishes a with a GSM (global system for mobile communications) cellular telephone service provider and transmits the pulse count to a central computer system. The pulse count can be transmitted to an analog modem at the computer site or to a website on the Internet and can be used for billing purposes.

Main Components

The SIP-CB Data Logger has a main circuit board containing a processor, memory and cellular radio. Attached to the main board is the interface board that provides a programming connection port, a SIM (Subscriber Identity Module) card holder, reset pins, LED indicators, connections to the battery and antenna and three terminal blocks for connections to alarm, call, tamper and pulse inputs and various outputs.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

L'enregistreur de données SIP-CB (Survey Instrument Point - Cellular/Battery) compte les impulsions provenant d'un compteur de gaz approuvé et équipé d'une sortie d'impulsions intégrée ou d'un dispositif approuvé de transmission de données représentant le volume de gaz. Le nombre d'impulsions est enregistré à intervalles réglables de 1 à 60 minutes. À l'heure prévue ou sur demande, l'enregistreur de données SIP-CB établit une liaison radio avec un service radio-téléphonique cellulaire du GSM (réseau mondial de téléphonie mobile) et transmet le compte d'impulsions à un système informatisé central. Le nombre d'impulsions peut être transmis au modem analogique d'un ordinateur ou à un site Web sur Internet et peut être utilisé à des fins de facturation.

Éléments principaux

L'enregistreur de données SIP-CB est doté d'une carte-mère comprenant un processeur, une mémoire et une radio cellulaire. La carte interface reliée à la carte mère comprend le port de raccord de programmation, le module d'identité de l'abonné, les broches de réinitialisation, les voyants DEL, les connexions pour le bloc-piles et l'antenne ainsi que trois borniers pour la connexion aux entrées d'impulsions d'alarme, d'appel, de protection antitraffiquage et diverses sorties.

The reset pins will reset the pulse count to zero when they are shorted. The LED indicators are used to indicate the initialization/diagnostic process of the SIP-CB Data Logger, data transfer when reading or programming the SIP-CB Data Logger, an error condition or the status of the radio, a call or a reset.

Inputs and Outputs

The pulse inputs can also be programmed as alarm inputs. The outputs can be programmed to replicate pulse or alarm inputs or can be used to control external devices. The call input can be used to force a call when the two terminals are shorted. The alarm inputs can be wired as customer specified alarms. The tamper input can be used to detect disconnection of an external cable or can be programmed as an alarm input.

Models

Five versions of the SIP-CB Data Logger are available: The following table identifies some differences in the input/output configurations for the different versions.

Les broches de réinitialisation remettent le nombre d'impulsions à zéro lorsqu'elles ferment le circuit. Les voyant DEL servent à annoncer le processus d'initialisation et de diagnostic de l'enregistreur de données SIP-CB, ainsi que le transfert de données lors de la lecture ou de la programmation de ce dernier, une condition d'erreur ou l'état de la radio et un appel ou une réinitialisation.

Entrées et sorties

Les impulsions d'entrée peuvent être programmées comme impulsions d'alarme. Les sorties peuvent être programmées de manière à reproduire les impulsions ou les entrées d'alarme ou peuvent être utilisées pour le contrôle des appareils externes. L'entrée d'appel peut servir à forcer un appel lorsque les deux borniers ferment le circuit. Les entrées d'alarme peuvent être câblées de manière à être spécifiques à un client. L'entrée de protection antitraffiquage peut servir pour détecter le débranchement d'un câble externe ou être programmé comme une entrée d'alarme.

Modèles

Cinq version de l'enregistreur de données SIP-CB sont disponibles : le tableau suivant présente quelques différences entre les configurations d'entrée-sortie des différentes versions.

**SIP-CB Data Logger Models: Number and Type of Inputs /
Modèles d'enregistreur de données SIP-CB : Numéro et type d'entrées**

Terminal Block / Bornier	Model / Modèle		
	2001-0195-005	2001-0195-006	2001-0198-001, -002, -003
TB3	1 Call input / entrée d'appel 1 Tamper input / entrée antitraffiquage 2 Alarm inputs / entrées d'alarme	1 Call input / entrée d'appel 1 Tamper input / entrée antitraffiquage	1 Call input / entrée d'appel 1 Tamper input / entrée antitraffiquage 2 Alarm inputs / entrées d'alarme
TB2	4 Outputs / sorties	2 Outputs / sorties	4 Outputs / sorties
TB1	4 Signal Inputs / entrées de signaux	2 Signal Inputs / entrées de signaux	4 Signal Inputs / entrées de signaux

Software

MP32 (Mercury Programmer)

Various parameters for the SIP-CB Data Logger can be viewed and programmed by connecting its program port via a programming cable to a computer loaded with the MP32 (Mercury Programmer) software. Programmable options include a phone number or an internet address to send the meter data to, the meter data storage interval, the input type, the pulse type, pulse parameters such as “*sample pulse width*”, “*sample rate*” and “*debounce cycles*” as well as various communications modes such as “*Originate Calls*” and “*Maintain Internet Connection*”. Programmable variables such as “*Primary Call Retry Count*” and “*Secondary Retry Interval*” determine how often calls will be made when the unit is in call retry mode.

DC2000 (Data Collection)

Mercury also provides a data collection software application entitled DC2000. The DC-2000 application typically resides on a central computer and can accept data from up to four pulse sources from one or more SIP-CB Data Loggers.

The SIP-CB Data Logger is initially programmed over the air, using the DC2000 software. Models 2001-0195-005 and 2001-0195-006 must then be configured for the firmware version 44 and models 2001-0198-001, -002 and -003 configured for firmware version 47 as these versions prevent remote programming using the DC2000 software. Any subsequent programming is done locally, using the MP32 software. The programming port required for local configuration is inside the sealed enclosure.

Logiciel

MP32 (Programmeur Mercury)

Le raccordement, au moyen d'un câble de programmation, du port de programme de l'enregistreur de données SIP-CB à un ordinateur équipé du logiciel MP32 (Programmeur Mercury) permet de voir et de programmer divers paramètres, parmi lesquels, un numéro de téléphone ou une adresse Internet de destination des données du compteur, l'intervalle d'enregistrement des données, le type d'entrée, le type d'impulsion, les paramètres d'impulsion tels que *la durée de l'impulsion d'échantillonnage, le taux d'échantillonnage, et les cycles antirebond* ainsi que divers modes de communication parmi lesquels : *Lancer des appels* et *Maintenir la connexion Internet*. Les variables programmables comme *Le comptage de rappel prioritaire* et *L'intervalle de rappel secondaire* déterminent à quelle fréquence les appels seront effectués lorsque l'enregistreur est en mode de rappel.

DC2000 (Collecte de données)

Mercury fournit également une application logicielle de collecte de données nommée DC2000. Cette application est logée dans un ordinateur central et peut accepter des données d'au plus quatre sources d'impulsions provenant d'un ou de plusieurs enregistreurs de données SIP-CB.

L'enregistreur de données SIP-CB est initialement téléprogrammé au moyen du logiciel DC2000. Les modèles 2001-0195-005 et 2001-0195-006 doivent alors être configurés pour la version 44 du micrologiciel et les modèles 2001-0198-001, -002 et -003, pour la version 47 du micrologiciel puisque ces versions empêchent la téléprogrammation au moyen du logiciel DC2000. Toute programmation subséquente est faite localement au moyen du logiciel MP32. Le port de programmation requis pour la configuration locale se trouve à l'intérieur du boîtier scellé.

Parameters to program using the DC2000 software are similar to those in the MP32 software as described previously. As well, the units of measure and any multiplier or division factors to apply to the pulse counts are programmed using the DC2000 software.

SPECIFICATIONS

Ambient temperature

Models 2001-0198-005 and - 006: - 20°C to +40°C
Models 2001-0198-001, -002, -003: -25°C to +40°C

Power

Models 2001-0198-005 and - 006: Lithium “DD” pack, 3.6 Vdc, 38 Ahr, Mercury Stock Number 1011-0044-001 or 1011-0046-001. Models 2001-0198-001, -002, -003 use a Lithium “DD” pack, 3.6 Vdc, 35 Ahr, Mercury Stock Number 1011-0053-001.

Expected battery life is 2 years for a typical configuration utilizing pulse sampling on the inputs and 7 calls of 60 seconds each per day

External 3.6 Vdc power supply

Les paramètres pour la programmation faite au moyen du logiciel DC2000 sont semblables à ceux du logiciel MP32 décrit ci-dessus. De plus, les unités de mesure ainsi que tous les facteurs de multiplicateur ou de diviseur à appliquer au compte d’impulsions sont programmées au moyen du logiciel DC2000.

SPÉCIFICATIONS

Température ambiante

Modèles 2001-0198-005 et -006: -20 °C à +40 °C
Modèles 2001-0198-001, -002, -003: -25°C à +40°C

Alimentation

Modèles 2001-0198-005 and - 006: Un bloc-piles Lithium “DD” pack, 3.6 Vdc, 38 Ahr, numéro de stock Mercury 1011-0044-001 or 1011-0046-001. Modèles 2001-0198-001, -002, -003 utilisent DD au lithium, 3,6 V c.c., 35 Ahr, numéro de stock Mercury 1011-0053-001.

La durée de vie des piles est de deux ans pour une configuration classique utilisant un échantillonnage d’impulsions aux entrées et 7 appels de 60 secondes chacun par jour.

Alimentation externe de 3,6 V c.c.

Signal InputsType of Pulse Inputs

Form A or C

Maximum input frequency

10 Hz

Wetting current and voltage per input100 μ A, 3.3 VdcWetting current Sample Pulse Width

0.0 to 950 ms (programmable)

Wetting current Sample Pulse Rate

0 to 50 samples per second (programmable)

Signaux d'entréeType d'entrées d'impulsions

Forme A ou C

Fréquence d'entrée maximale

10 Hz

Courant et tension de mouillage par entrée100 μ A, 3,3 V c.c.Durée de l'impulsion de l'échantillon pour le courant de mouillage

0,0 à 950 sm (programmable)

Taux d'impulsions de l'échantillon de courant de mouillage

0 à 50 échantillons par seconde (programmable)

Cellular Radio

Motorola g24 GSM (global system for mobile communications) GPRS (general packet radio service)

Radio cellulaire

Motorola g24 GSM (réseau mondial de téléphonie mobile) GPRS (Service général de données radio en mode paquet)

Nominal Frequencies / Fréquences nominales	Receive Frequencies / Fréquences de réception	Transmit Frequencies / Fréquences d'émission
850 MHz	824 - 849 MHz	869 - 894 MHz
900 MHz	880 - 915 MHz	880 - 915 MHz
1800 MHz	1805 - 1880 MHz	1710 - 1785 MHz
1900 MHz	1930 - 1990 MHz	1850 - 1910 MHz

Firmware

Firmware Version: 44 for models 2001-0198-005 and - 006.

Firmware Version: 47 for models 2001-0198-001, - 002, -003

The firmware version can be viewed on the main configuration screen of the MP32 software when "Read" is selected while the program port of the SIP-CB Data Logger is connected to a computer via a programming cable.

The firmware version can also be verified by contacting Metretek and providing the serial number of the unit.

EXEMPTIONS

Exempt from LMB-EG-08, 3-4.1, low battery warning

MARKINGS

The SIP-CB Data Logger is marked with information in accordance with sections 3-5.1 a, b, c, d and e (with clarifications noted below), 3-5.2 and 21-2.4 a, c, d and e (with the exception noted) of LMB-EG-08.

Micrologiciel

Version du micrologiciel : 44 pour les modèles 2001-0198-005 et - 006.

Version du micrologiciel: 47 pour les modèles 2001-0198-001, -002, -003

La version du micrologiciel est visible sur l'écran de configuration du logiciel MP32 lorsqu'on sélectionne "Read" (Lire) pendant que le port de programmation de l'enregistreur de données SIP-CB est relié à un ordinateur par un câble de programmation.

On peut également vérifier la version de micrologiciel auprès de Metretek en indiquant le numéro de série de l'appareil.

EXEMPTIONS

Exempter de l'indicateur de faiblesse des piles prescrit par la norme LMB-EG-08, 3-4.1.

MARQUAGE

Le marquage de l'enregistreur de données SIP-CB comprend les renseignements suivants, conformément aux exigences des sections 3-5.1 a, b, c, d et e (explications ci-dessous), 3-5.2 et 21-2.4 a, c, d et e (avec l'exception signalée auparavant) de la norme LMB-EG-08.

3-5.1 b, Model Number

The SIP-CB Data Logger has two model numbers that identify the number of signal inputs available:

2001-0195-005, 2001-0198-001, -002, -003 (4 Signal Inputs)

2001-0195-006 (2 Signal Inputs)

3-5.1 c, Serial Number

The number marked under the bar code serves as the serial number.

21-2.4 b, Minimum Input Voltage

Not applicable: The SIP-CB Data Logger provides the voltage (3.3 Vdc nominal) to sense a contact that is described as dry (no voltage present) such as a conventional reed switch or an open collector transistor.

SEALING

Once the SIP-CB Data Logger has been configured using the DC2000 software and the firmware version set to 44 for models 2001-0198-005, -006 or 47 for models 2001-0198-001, -002, -003, the SIP-CB Data Logger can not be configured remotely. It can only be configured locally through the program port as described previously under the Software section in this approval.

For models 2001-0195-005 and 2001-0195-006, the access to the program port and the input connections inside the enclosure is protected by passing a sealing wire through two holes in a metal plate and then joining the two ends of the wire with a lead seal. The metal plate is positioned so that it blocks access to the top two screws of the enclosure. See Fig. 5.

3-5.1 b, Numéro de modèle

L'enregistreur de données SIP-CB a deux numéros de modèle, selon le nombre d'entrées de signaux disponibles :

2001-0195-005, 2001-0198-001, -002, -003 (4 entrées de signaux)

2001-0195-006 (2 entrées de signaux)

3-5.1 c, Numéro de série

Le numéro inscrit sous le code à barres sert de numéro de série.

21-2.4 b, Tension d'entrée minimale

Sans objet : L'enregistreur de données SIP-CB produit une tension (nominale de 3,3 V c.c.) pour détecter un contact décrit comme sec (aucune tension présente) comme un commutateur à lame ou un transistor en collecteur ouvert.

SCELLAGE

L'enregistreur de données SIP-CB, une fois configuré au moyen du logiciel DC200 et de la version 44 du micrologiciel pour les modèles 2001-0198-005 et -006 ou de la version 47 du micrologiciel pour les modèles 2001-0198-001, -002, -003 , ne peut plus être configuré à distance. Il ne peut être configuré que localement à travers le port de programmation décrit ci-dessus dans la section Logiciel du présent avis d'approbation.

Pour les modèles 2001-0195-005 et 2001-0195-006, l'accès au port de programmation et à la borne d'entrée situés à l'intérieur du boîtier est protégé par un fil métallique passé à travers deux trous dans la plaque métallique et dont les deux extrémités sont jointes par un sceau en plomb. La plaque métallique est placée de manière à bloquer l'accès au deux vis sur le dessus du boîtier. Voir Fig. 5.

Exclusive only to the model 2001-0198-001 SIP-CB data logger, the sealing arrangement requires the installation of a metal plate to block access to two of the enclosure's screws at the bottom rear of the SIP-CB. See Fig. 8 and 9.

For models 2001-0198-002 and 2001-0198-003 the sealing provisions require that a conventional wire and lead seal be applied directly to the door latch of the enclosure.

REVISIONS

The purpose of revision 1 is to add three new models of the SIP-CB data Logger Series, 2001-0198-001, 2001-0198-002 and 2001-0198-003. These models are variations of the originally approved models. They utilize antennas that mount onto the outside of the enclosure. Minor electrical and mechanical changes were also incorporated into these models. Models 2001-0198-002 and 003 utilize a larger enclosure.

EVALUATED BY

Judy Farwick
Senior Legal Metrologist
Tel: (613) 946-8185
Fax: (613) 952-1754
E-mail: farwick.judy@ic.gc.ca

And:

Kulwant Gill
Legal Metrologist
Tel: (613) 957-1554
Fax: (613) 952-1754
E-mail: gill.kulwants@ic.gc.ca

Revision 1

Randy Byrtus, C.E.T.
Manager, Gas Measurement
Telephone: 613-952-0631
Facsimile: 613-951-1754
Email: randy.byrtus@ic.gc.ca

Le dispositif de scellage, qui est exclusif au modèle 2001-0198-001 SIP-CB d'enregistreur de données, exige l'installation d'une plaque de métal pour bloquer l'accès à deux des vis du boîtier situées sur le fond à l'arrière du SIP-CB. Voir fig. 8 et 9.

En ce qui concerne les modèles 2001-0198-002 et 2001-0198-003, le dispositif de scellage exige d'utiliser un fil et un sceau en plomb classiques apposés directement sur le verrou de la porte du boîtier.

RÉVISIONS

Le but de la révision 1 est d'ajouter ces trois nouveaux modèles d'enregistreur de données séries SIP-CB ; 2001-0198-001, 2001-0198-002 and 2001-0198-003. Ces modèles sont des variantes du modèle originalement approuvé. Ils utilisent des antennes montées sur la partie extérieure du boîtier. Quelques changements électronique et mécanique mineurs ont aussi été incorporés dans ces modèles. Les modèles 2001-0198-002 et 003 utilisent un boîtier plus large.

ÉVALUÉ PAR

Judy Farwick
Métrologue légal principale
Tél. : 613-946-8185
Télé. : 613-952-1754
Courriel : farwick.judy@ic.gc.ca

Et:

Kulwant Gill
Métrologue légal
Tél. : 613-957-1554
Télé. : 613-952-1754
Courriel : gill.kulwants@ic.gc.ca

Révision 1

Randy Byrtus, T.E.C.
Gestionnaire, Mesures des gaz
Téléphone 613-952-0631
Télécopieur 613-952-1754
Courriel : randy.byrtus@ic.gc.ca

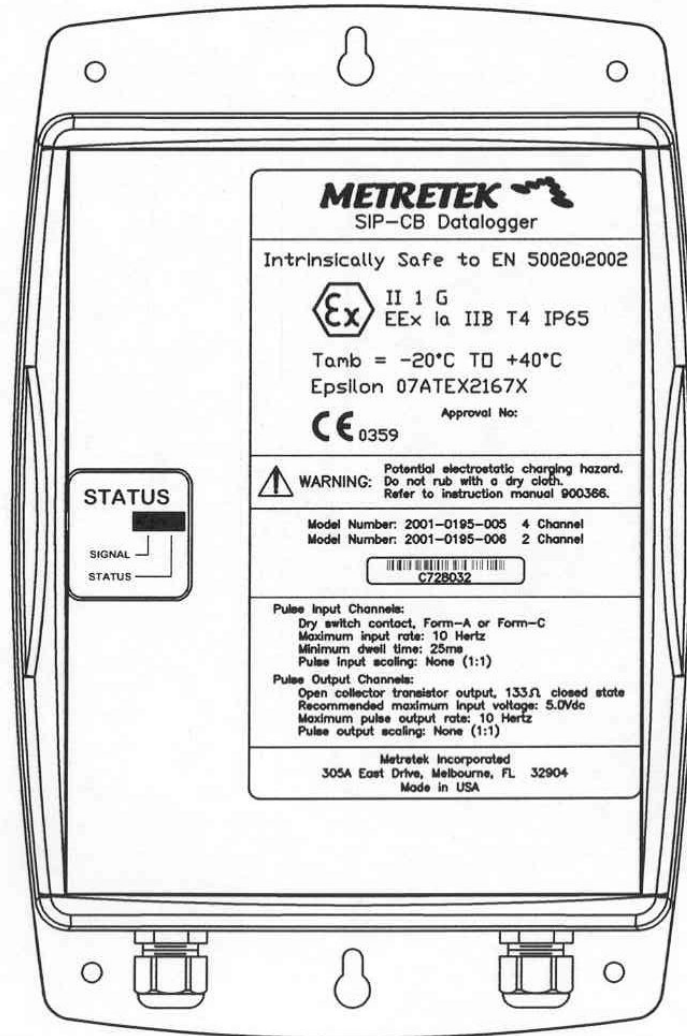


Fig. 1 : SIP-CB Data Logger, top cover / Couvercle supérieur de l'enregistreur de données SIP-CB

Stock Number: 2001-0195-005 4 Channel []
 Stock Number: 2001-0195-006 2 Channel []
 1 Pulse = [] Cubic Feet [] Cubic Meters []
 Form A [] Form C [] IC: 123 4567 B

Fig. 2 : Marking label / Étiquette de marquage

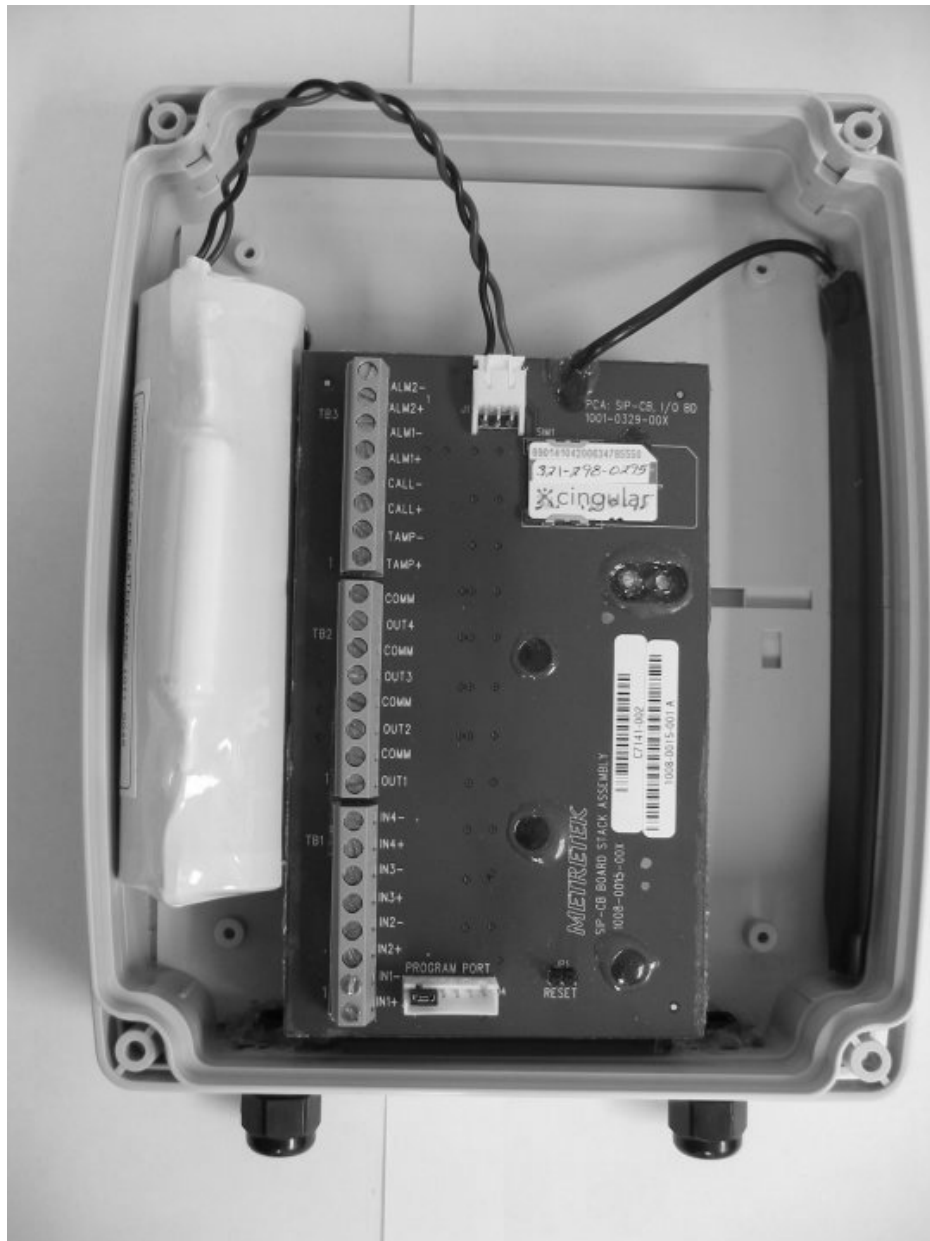
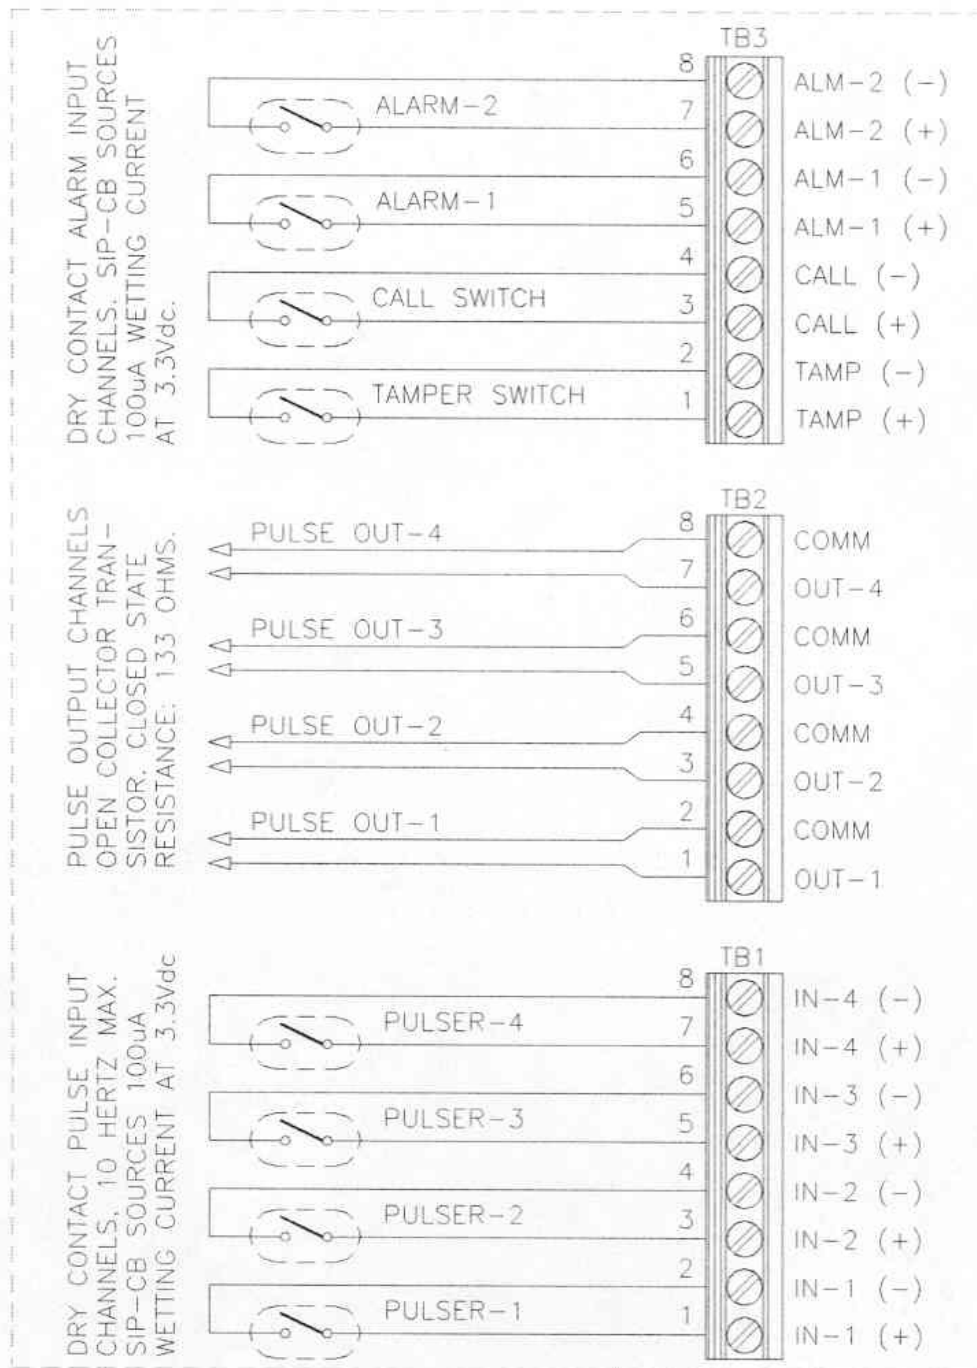
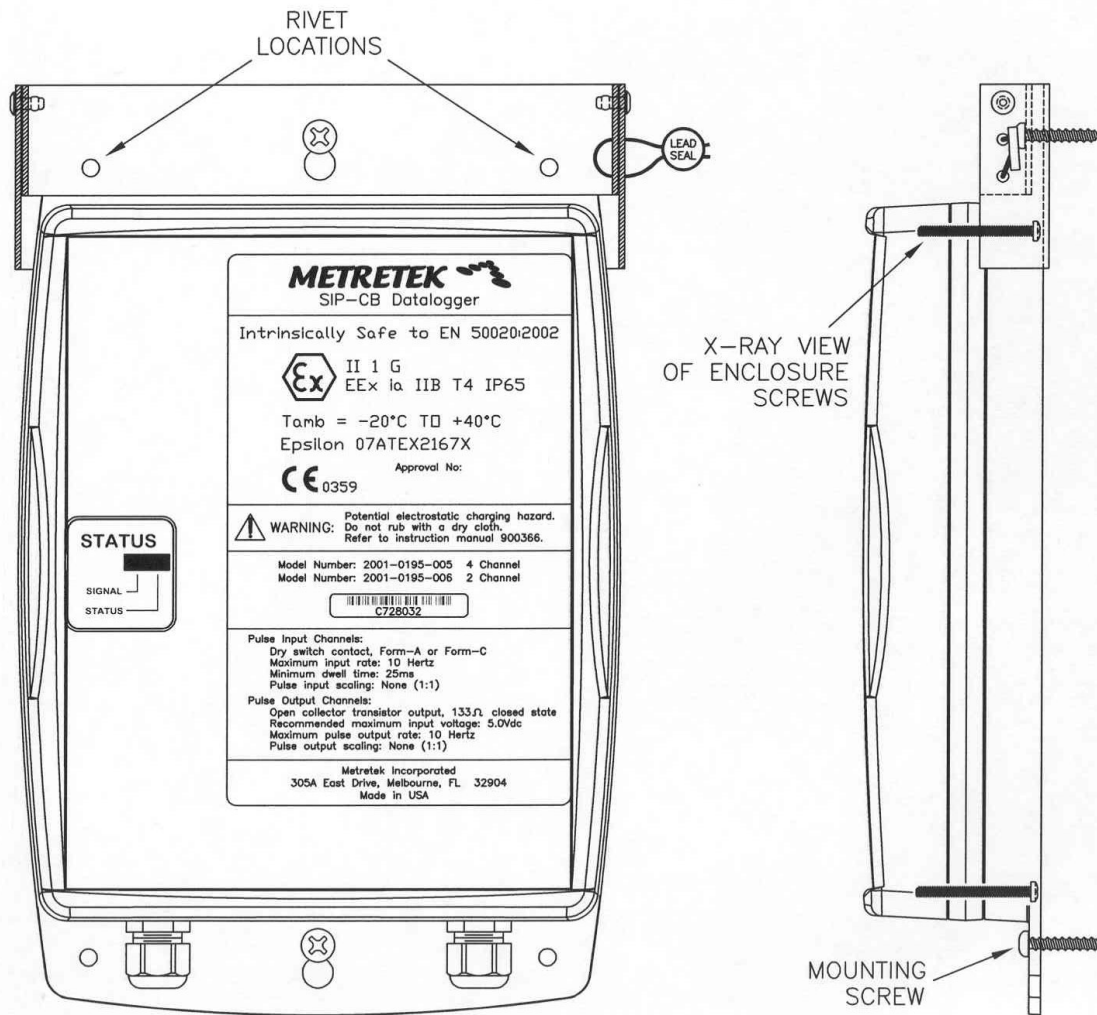


Fig. 3 : SIP-CB Data Logger, inside top cover / À l'intérieur du couvercle supérieur de l'enregistreur de données SIP-CB



**Fig. 4 : SIP-CB Data Logger, Connection Diagram /
Schéma de connexions de l'enregistreur de données SIP-CB**



**Fig. 5 : SIP-CB Data Logger, sealing provisions /
Disposition de scellage de l'enregistreur de données SIP-CB**

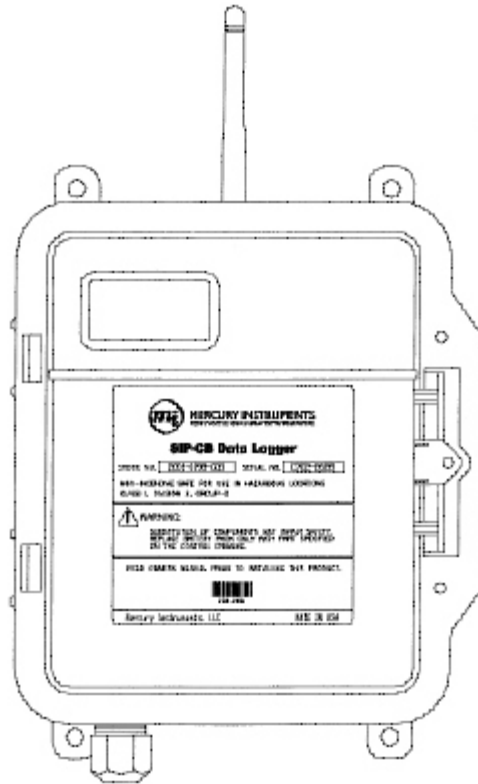


Fig. 6 Model\Modèle 2001-0198-

003

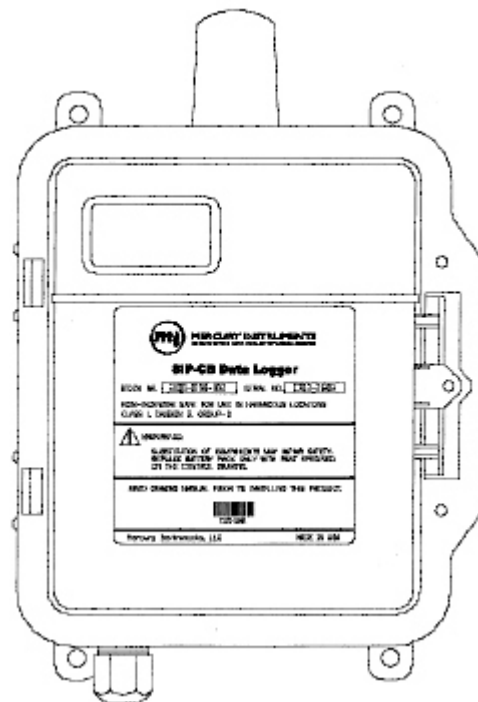


Fig. 7 Model\Modèle 2001-0198-002

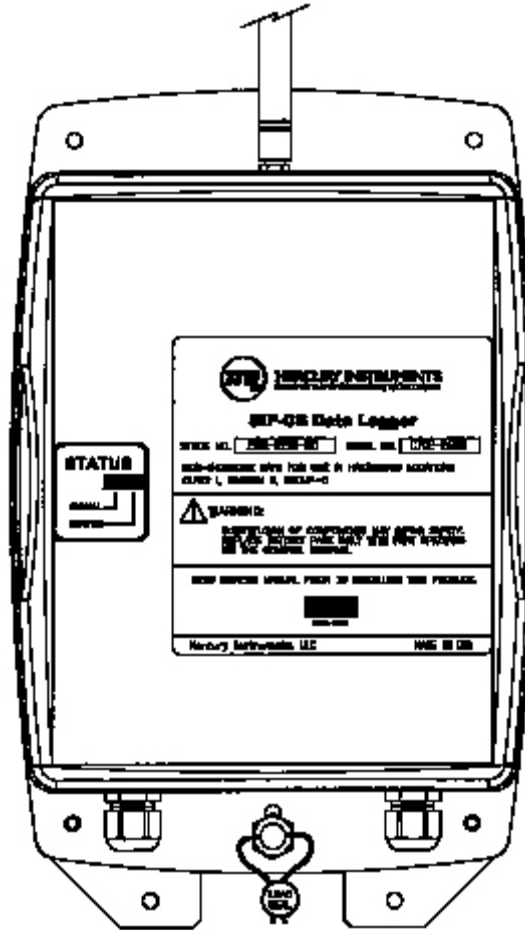


Fig. 8 Model 2001-0198-001 with seal attached / Modèle 2001-0198-001 avec sceau attaché

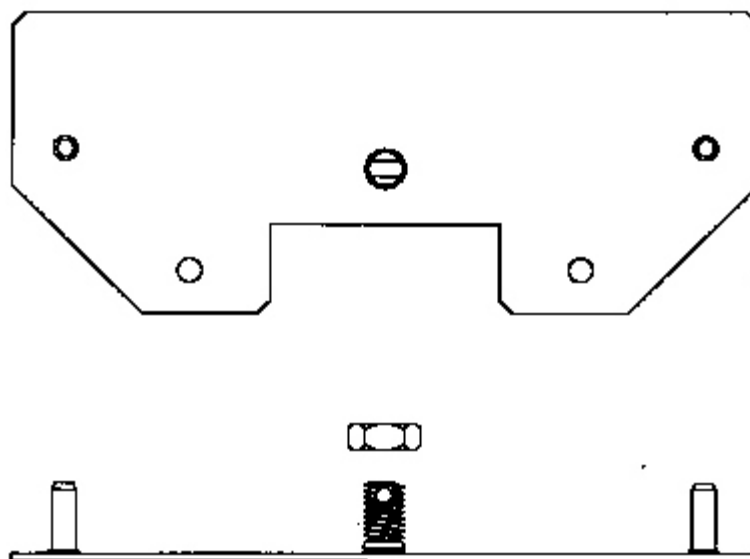


Fig. 9 Security Plate for model 2001-0198-001 / Plaque de sécurité pour modèle 2001-0198-001

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Patrick J. Hardock, P.Eng.
Senior Engineer – Gas Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis en vertu de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par :

Patrick J. Hardock, P.Eng.
Ingénieur principal – Mesure des gaz
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: 2009-07-07

Web Site Address / Adresse du site internet :
<http://mc.ic.gc.ca>