



Measurement Canada
An Agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AM-5692 Rev. 2

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for the following device model(s):

TYPE OF DEVICE

Electronic Bench Scale

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

TYPE D'APPAREIL

Balance électronique de table

APPLICANT

A&D Engineering
1756 Automation Pkwy
San Jose, California
95131 USA / É.U.

REQUÉRANT

A&D Engineering
1756 Automation Pkwy
San Jose, California
95131 USA / É.U.

MANUFACTURER

FABRICANT

MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)

FX-120*
FX-200*
FX-300*
FX-600CT
FX-1200*
FX-2000*
FX-3000*

USE

- General Use
 Restricted use

USAGE

- Usage général
 Usage restreint

SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C" "(complete)" in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" "(modular)" have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [], d ≠ e.
 E_{max} : load cell capacity

PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un "C" "(complet)" à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un "M" "(modulaire)" ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe "X" indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe "---" indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [], d ≠ e.
 E_{max} : portée de la cellule de pesage.

SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics
PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils

1 Model Modèle	2 C or/ou M	3 Class Classe	4 Max	5 E_{max}	6 e [d]	7 n_{max}	8 e_{min}	9 Temp
FX-120iN			122 g					
FX-120iWPN			0.26895 lb					
FX-120iN-P			4.3035 oz					
FX-120iWPN-P			3.9225 tr oz					
FX-200iN			220 g	320 g	0.01 g [0.001 g]			
FX-200iWPN			0.48590 lb		0.00005 lb			
FX-200iN-P			7.7605 oz		0.0005 oz			
FX-200iWPN-P			7.0735 tr oz		0.0005 tr oz			
FX-300iN			320 g					
FX-300iWPN			0.70545 lb					
FX-300iN-P			11.2875 oz					
FX-300iWPN-P			10.2885 tr oz	350 g				
FX-120GD			122 g	320 g	0.01 g [0.001 g]			
FX-200GD			220 g					
FX-300GD	C	II	320 g	350 g		---	---	+10°C to/à 30°C
FX-600CT			122 g 610 ct	122 g	0.01 g 0.05 ct			
FX-1200iN			1220 g					
FX-1200iWPN			2.689 lb					
FX-1200iN-P			43.03 oz					
FX-1200iWPN-P			39.22 tr oz		0.1 g [0.01 g]			
FX-2000iN			2200 g		0.001 lb			
FX-2000iWPN			4.85 lb		[0.0001 lb]			
FX-2000iN-P			77.6 oz		0.01 oz			
FX-2000iWPN-P			70.73 tr oz		[0.001 oz]			
FX-3000iN			3200 g		0.01 tr oz			
FX-3000iWPN			7.05 lb		[0.001 tr oz]			
FX-3000iN-P			112.87 oz					
FX-3000iWPN-P			102.88 tr oz					

SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics (continued)
PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils (suite)

1 Model Modèle	2 C or/ou M	3 Class Classe	4 Max	5 E_{max}	6 e [d]	7 n_{max}	8 e_{min}	9 Temp
FX-1200GD			1220 g					
FX-2000GD	C	II	2200 g	3500 g	0.1 g [0.01 g]	---	---	+10°C to/à 30°C
FX-3000GD			3200 g					

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations:

“iN” indicates base model.

“iWPN” indicates model for harsh environment applications.

“GD” indicates model in grams only.

“CT” indicates model in grams and carats only

The addition of “-P” to a model indicates it has a counting function. See Section 5. /

“iN” indique le modèle de base.

“iWPN” indique un modèle pour utilisation en milieu agressif.

“GD” indique un modèle utilisant des grammes seulement.

“CT” indique un modèle utilisant des grammes et carats seulement.

L'ajout de “-P” pour un modèle indique qu'il a une fonction de comptage. Voir partie 5.

SECTION 3 - Device Description

If an “X” appears in table columns, it means that the function or the element is present while a “- - -” indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

PARTIE 3 - Description de l'appareil

Le symbole “X” qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole “- - -” signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui ou celle-ci ne s'applique pas.

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features
PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux

Models/Modèles →	FX-120*, FX-200*, FX-300*, FX-600CT, FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
General / Générales	
Material/Matériel	Aluminium
Power Supply/Alimentation électrique	
① V AC / V c.a.	② 12 V DC / c.c.
② V DC / V c.c.	③ 120 V AC to 12 V DC adapter / adaptateur de 120 V c.a. à 12 V c.c.
③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	
Communication Port(s)/ Port(s) de communication	X

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features
(continued)**
PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

Models/Modèles ➔	FX-120*, FX-200*, FX-300*, FX-600CT, FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
① Single Range/Étendue simple ② Multi-Interval/Échelons multiples ③ Multiple Range/Étendue multiple	①
Integrated Printer/Imprimante intégrée	---
Signal received/Signal reçu ① Analog/Analogue ② Digital /Numérique	---
Metrological Functions / Fonctions métrologiques	
Zero Setting Mechanisms (ZSM)/ Dispositif de mise à zéro (DMZ) ① Automatic Zero Tracking (AZTM) / Maintien du zéro automatique (AZTM) ② Automatic (AZSM)/automatique (DMZA) ③ Semi-Automatic (SAZSM) / semi-automatique (DMZSA) ④ Initial (IZSM) / initial (DMZI) ⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM)	①③ ¹ ④ ²
T (Type) ① Platter/Plateau Keyboard/clavier ② ③ % Automatic/automatique ④ ⑤ Proportional/proportionnelle ⑥ Programmable	---
Price Computation/Calcul des prix ① \$/kg \$/lb ② ③ \$/100 g (<i>Postal Scales Only</i>) \$/oz ④	---
Weigh-in - weigh-out/ Pesage entrée - sortie	---
Sleep Mode/Mode sommeil ① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt	②
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations: 1. SAZSM exceeds 4% and can be set to capacity. / Le DMZSA excède 4% et peut être réglé à pleine portée 2. IZSM exceeds 20% and can be set to capacity. / Le DMZI excède 20% et peut être réglé à pleine portée	

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features
(continued)****PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)**

Models/Modèles	FX-120*, FX-200*, FX-300*, FX-600CT, FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
Operator's Display / Affichage destiné à l'opérateur	
Number of Display Windows/Nombre de fenêtres d'affichage	1
Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres	①③ Vacuum fluorescent display (VFD) / Affichage fluorescent sous vide - 7 digits / chiffres - 7 segments
① Gross/Brut Tare ②	
③ Net Unit Price/Prix unitaire ④	
⑤ Total Price/Prix total	
Units of measure /Unités de mesure	Models with the suffix /Modèles avec le suffixe
	“iN”, “iN-P”, “iWPN” and/et “iWPN-P”

	“GD”

	“CT”
	Units of measure /Unités de mesure
	g, lb, oz, tr oz

	g

	g, ct
Metrological Annunciators/ Voyants métrologiques:	① ③ ④
① Net Weight/Poids net	
② Centre of Zero/Centre du zéro	
③ Unit of measure/Unité de mesure	
④ Motion/Mouvement	
⑤ Tare Entered/Entrée de tare	
⑥ Range Selection/Sélection de l'étendue	
⑦ Weighing Element Selection/Sélection du dispositif peseur	
⑧ Prepackaging/Pré-emballage	
⑨ Low Battery/Piles faibles	
⑩ Other/Autres	
Customers' Display / Affichage destiné aux clients	
	NA / s.o.
Keyboard and Operator Controls/Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur	
Total Number of Keys/ Nombre total de touches	6
Numeric Keypad/Clavier numérique	---
Zero Key/Touche zéro	X
Tare Key/Touche de tare	---

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features
(continued)**
PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

Models/Modèles ➔	FX-120*, FX-200*, FX-300*, FX-600CT, FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
Selection Key/Touche de sélection Gross Mode/Mode brut ➔ Net ➔ Tare	---
Unit of measure selection key/Touche de sélection d'unité de mesure	X
Clear Key/Touche pour effacer	---
Range Selection/Sélection de l'étendue	---
Weighing Element Selection/ Sélection du dispositif peseur	---
Price Look Up(PLU)/ Touche Rappel du prix (TRP)	---

SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features
PARTIE 3 -TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs

Models/Modèles ➔	FX-600CT	FX-120*, FX-200*, FX-300iN, FX-300iN-P, FX-300iWPN, FX-300iWPN-P	FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
General / Générales			
Platter Dimensions/Dimensions du plateau	Ø 90 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Power Supply/Alimentation électrique ① V AC / V c.a. ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.		See Table 2 / Voir tableau 2	
Material /Matériau ① Housing/Boîtier ② Frame/Châssis ③ Sub-frame/Sous châssis ④ Platter/Plateau		① ④ Aluminium ② Stainless steel / acier inoxydable ③ ABS Plastic / plastique ABS	
Level/Niveau		X	
Adjustable Feet/Pieds réglables		X	
Stops/Butées		---	
Signal transmitted/Signal transmis ① Analog/Analogue ② Digital/Numérique		---	
Installation ① Permanent/Permanente ② Mobile		②	

**SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features
(continued)**
PARTIE 3 -TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs (suite)

Models/Modèles ➔	FX-120*, FX-200*, FX-300*, FX-600CT, FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
Load Cells / Cellules de pesage	
Number of Load Cells/Nombre de cellules de pesage	1
Type	Electromagnetic force compensation / À compensation électromagnétique des forces
Assembly/Montage ① Bolted/Boulonnée(s) ② Other/Autre *	①
Location/Localisation	Bolted to the sub-platter, at the centre of the base / Boulonnée au sous-plateau, au centre de la base
Load Transmission/Transmission de la charge ① Direct ② Indirect	①

SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters
PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration

Models/Modèles ➔	FX-120*, FX-200*, FX-300*, FX-600CT, FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques ② Physical Seal / Scellé physique	②
Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques Categories / Catégories ③ Category 1 / Catégorie 1 ④ Category 2 / Catégorie 2 ⑤ Category 3 / Catégorie 3	---
Method of Sealing / Méthode de scellage ⑥ Wire and Seal / Fil et scellé ⑦ Paper Seal / Scellé papier ⑧ Event Counters / Compteurs d'événements ⑨ Event logger/ Enregistreur d'événements ⑩ Other / Autre	⑥ see photos / voir les photos

SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements
PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage

Models/Modèles ➔	FX-120*, FX-200*, FX-300*, FX-600CT, FX-1200*, FX-2000*, FX-3000*
① Counting Function / Fonction de comptage ② Over-under Target Function / fonction au-delà et en deçà de la cible ③ Device Installation / Installation de l'appareil ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement ⑤ Other / Autre	① ② <p>While the functions ① and ② can be used for trade transactions, they have not been evaluated by Measurement Canada and are not covered by this Notice of Approval. / Bien que les fonctions ① et ② puissent être utilisées dans des transactions commerciales, elles n'ont pas été évaluées par Mesures Canada et ne sont pas couvertes par le présent avis d'approbation.</p>

SECTION 6 - Limitations and Use Requirements

The device is approved for top load weighing. The under-hook is not approved for use in trade.

PARTIE 6 - Les restrictions/exigences d'utilisation

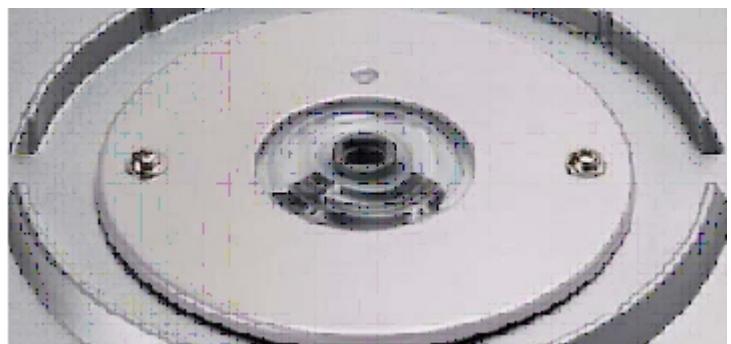
Cet appareil est approuvé pour le pesage sur le plateau. Le crochet du dessous n'est pas approuvé pour l'utilisation dans le commerce.

SECTION 7 - Terms and Conditions

NA

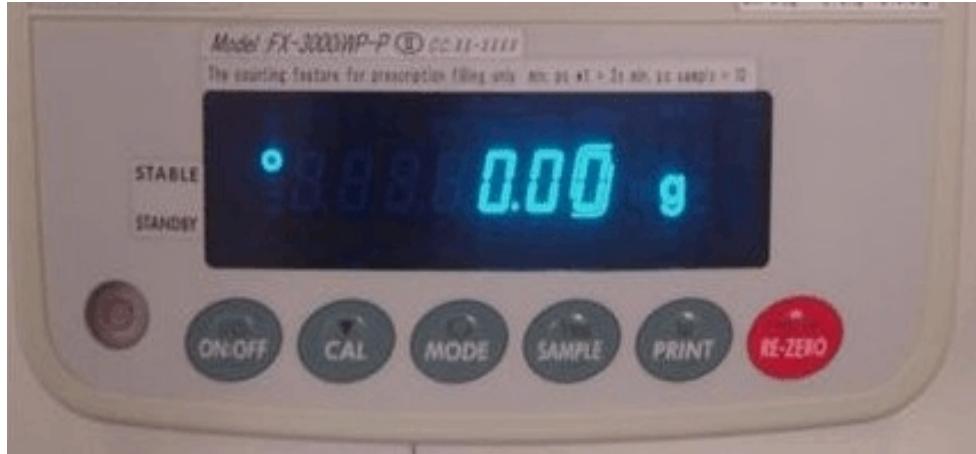
S.O.

SECTION 8 - Photographs and Drawings

Typical sealing / Scellage typique

Typical sub-platter / sous-plateau typique

SECTION 8 - Photographs and Drawings (continued)

PARTIE 8 - Les photos et les sketches (suite)



Typical display and keyboard / Affichage et touches typiques



Typical model FX-3000iN and FX-300iN / Modèles typiques FX-3000iN et FX-300iN

SECTION 8 - Photographs and Drawings (continued)

PARTIE 8 - Les photos et les sketches (suite)



Typical model FX-600CT / Modèle FX600CT typique

PARTIE 9 - Évalué par

SECTION 9 - Evaluated by:

This device was evaluated by:

Cet appareil a été évalué par:

Original: Ryan Henshaw
Legal Metrologist

Issue Date: 2009-01-28

Original: Ryan Henshaw
Métrologiste légal

Date d'émission: 2009-01-28

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition
Agreement

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle
États-Unis/Canada

Revision 1: Ryan Henshaw
Legal Metrologist

Issue Date: 2010-03-03

Révision 1: Ryan Henshaw
Métrologiste légal

Date d'émission: 2010-03-03

Tested by Measurement Canada

Testé par Mesures Canada

Revision 2: Ryan Henshaw
Senior Legal Metrologist

Révision 2: Ryan Henshaw
Métrologiste légal principal

Tested by Measurement Canada

Testé par Mesures Canada

SECTION 10 - Revision**Revision 1**

The purpose of revision 1 was to add the models with the iN-P, iWPN-P and CT suffixes and to modify some existing model designations.

Revision 2

The purpose of revision 2 is to specify that the SAZSM and IZSM can be set to capacity.

SECTION 11 - Approval

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the *Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices*. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the *Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices*.

PARTIE 10 - Révision**Révision 1**

La révision 1 visait à ajouter les modèles avec les suffixes iN-P, iWPN-P et CT et à modifier la désignation de certains modèles.

Révision 2

La révision 1 vise à spécifier que le DMZSA et le DMZI peuvent être réglés à pleine portée.

PARTIE 11 - Approbation

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

SECTION 12 - Signature and Date

Original copy signed by:

Nathalie Dupuis-Désormeaux
B.A.Sc. (Mechanical Engineering), M.Sc. (Mathematics)
Senior Engineer - Gravimetry
Engineering and Laboratory Services Directorate

Notice of Approval issued on:

PARTIE 12 - Signature et date

Copie authentique signée par:

Nathalie Dupuis-Désormeaux
B.Sc.A. (Génie mécanique), M.Sc (Mathématiques)
Ingénierie principale - Gravimétrie
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Avis d'approbation émis le : **2011-01-18**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>